



Hillrom™

**Welch Allyn®
iExaminer™ Pro**



Welch Allyn iExaminer Pro lietojne

238-3 Welch Allyn MacroView Plus otoskops

118-3 Welch Allyn PanOptic Plus oftalmoskops

11840-IEX Welch Allyn SmartBracket montāža

Lietošanas pamācība

Programmatūras versija 3.1.x

Tikai profesionālai lietošanai

R_x ONLY

Darbības režīms: skatiet atbilstīgo uzgaļu lietošanas pamācību.

© 2023 Welch Allyn, Inc. Visas tiesības paturētas. Nevienam nekādā veidā nav atļauts reproducēt vai kopēt šo lietošanas pamācību vai jebkuru tās daļu bez Welch Allyn atļaujas. Welch Allyn® ir Welch Allyn, Inc. preču zīme. Hillrom™ ir Hill-Rom Services, Inc. preču zīme.

App Store® ir Apple, Inc. reģistrēta preču zīme. Android™ un Google Play™ ir Google, Inc. preču zīmes. Citas preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi ir attiecīgo īpašnieku preču zīmes.

Hill-Rom patur tiesības veikt konstrukcijas, specifikāciju un modeļu izmaiņas bez iepriekšēja paziņojuma. Hill-Rom nodrošinātā vienīgā garantija ir tieša rakstiska garantija, kas ir paplašināta attiecībā uz izstrādājumu pārdošanu vai nomu.

Uzņēmums Welch Allyn, Inc. ("Welch Allyn") neuzņemas atbildību par traumām, kas var rasties: i) izstrādājuma nepareizas lietošanas dēļ saskaņā ar šajā pamācībā publicētajām instrukcijām, piesardzības pasākumiem, brīdinājumiem vai paziņojumu par paredzēto lietojumu; ii) jebkuras izstrādājuma nelikumīgas vai nepareizas lietošanas rezultātā.

PATENTS/PATENTI hillrom.com/patents

Var ietvert vienu vai vairākus patentus. Skatiet iepriekš minēto interneta adresi. Hill-Rom uzņēmumi ir Eiropas, ASV un citu patentu, kā arī izskatīšanai iesniegto patentu pieteikumu īpašnieki.

Welch Allyn tehniskais atbalsts

<https://hillrom.com/en-us/about-us/locations>

Paziņojums lietotājiem un/vai pacientiem ES: Par jebkādu nopietnu ar šo ierīci saistītu negadījumu ir jāziņo ražotājam un kompetentajai tās dalībvalsts iestādei, kura ir lietotāja un/vai pacienta mītnes zeme.

901161 iEXAMINER PRO SW APP iOS

901162 iEXAMINER PRO SW APP ANDROID

REF IEXAMINER PRO IOS

REF IEXAMINER PRO ANDR

DIR 80030522 Ver. A Pārskatīšanas datums: 2023-09

 Welch Allyn, Inc.
4341 State Street Road
Skaneateles Falls, NY 13153 USA
hillrom.com

Pilnvarots Austrālijas sponsors
Welch Allyn Australia Pty. Ltd.
Unit 4.01, 2-4 Lyonpark Road
Macquarie Park, NSW 2113
Tālrunis 1800 650 083

Welch Allyn, Inc. ir Hill-Rom Holdings, Inc. meitasuzņēmums.
Ražots ASV



Hillrom™

Saturs

Ierīces apraksts	1
Paredzētais lietojums	1
Kontrindikācijas	2
Veiktspējas raksturlielumi	2
Simbolu definīcijas.....	3
Brīdinājumi un piesardzības pasākumi	4
Atlikušais risks.....	5
Ierīces un pacienta dati un drošība.....	6
Lietošana pirmo reizi.....	7
Norādījumi par viedtālruna un korpusa izvēli ...	9
Montāžas pārbaude	10
Lietotnes funkciju izmantošana	11
iOS norādes	12
Ekrāna elementi (iOS)	12
Iestatījumu modificēšana (iOS)	13
Autentifikācija (iOS)	14
Paroles iestatīšana (iOS)	14
Paroles atiestatīšana (iOS).....	15
Pieteikšanās (iOS).....	16
Izmeklējumi, kuriem beidzies derīguma termiņš (iOS)	17
Izmeklējumi, kuriem drīz beigsies derīguma termiņš (iOS).....	22
Izmeklējuma pievienošana (iOS)	23
Attēlu tveršana (iOS)	24
Attēlu atlasīšana (iOS).....	27
Atlasīto attēlu skatīšana (iOS)	28
Izmeklējuma saglabāšana (iOS)	30
Saglabāta izmeklējuma atjaunināšana (iOS) ...	31
Izmeklējuma koplietošana (iOS).....	33

Attēla koplietošana (iOS).....	35
Izmeklējuma dzēšana (iOS)	37
Izmeklējuma atmešana (iOS)	38
Android norādes.....	39
Ekrāna elementi (Android)	39
Iestatījumu modificēšana (Android)	40
Autentifikācija (Android)	41
Paroles iestatīšana (Android)	41
Paroles atiestatīšana (Android)	42
Pieteikšanās (Android)	43
Izmeklējumi, kuriem beidzies derīguma termiņš (Android).....	44
Izmeklējumi, kuriem drīz beigsies derīguma termiņš (Android).....	50
Izmeklējuma pievienošana (Android)	51
Attēlu tveršana (Android).....	52
Attēlu atlasīšana (Android)	55
Atlasītā attēla skatīšana (Android)	56
Izmeklējuma saglabāšana (Android)	58
Saglabāta izmeklējuma atjaunināšana (Android)	59
Izmeklējuma koplietošana (Android)	61
Attēla koplietošana (Android)	63
Izmeklējuma dzēšana (Android).....	65
Izmeklējuma atmešana (Android).....	66
Tīrīšana	67
Droša utilizācija	68
EMS atbilstība	68
Glabāšana un transportēšana.....	69
Piederumi.....	69
Saderīgās ierīces	69
Garantija	70

Ierīces apraksts

Lietotne iExaminer ir līdzvērtīga lietotnei Welch Allyn iExaminer Pro.

Sistēmā iExaminer ar MacroView Plus ir iekļauts MacroView Plus, SmartBracket, SmartClip, lietotne iExaminer un viedtālrunis ar korpusu, kas atbilst [“Norādījumi par viedtālruna un korpusa izvēli”](#).

Sistēmā iExaminer ar PanOptic Plus ir iekļauts PanOptic Plus, SmartBracket, SmartClip, lietotne iExaminer, kā arī viedtālrunis ar korpusu, kas atbilst [“Norādījumi par viedtālruna un korpusa izvēli”](#).

Paredzētais lietojums

Lietotne iExaminer ar atbilstošām Welch Allyn ierīcēm ir paredzēta lietošanai klīnicistiem un medicīniski kvalificētiem darbiniekiem, lai tvertu un nosūtītu bērnu un pieaugušu pacientu attēlus.

Sistēma iExaminer ar MacroView Plus ir paredzēta lietošanai klīnicistiem un medicīniski kvalificētiem darbiniekiem, lai tvertu un nosūtītu bērnu un pieaugušu pacientu ārējās auss, auss kanāla un bungplēvītes attēlus.

Sistēma iExaminer ar PanOptic Plus ir paredzēta lietošanai klīnicistiem un medicīniski kvalificētiem darbiniekiem, lai tvertu un nosūtītu bērnu un pieaugušu pacientu acs attēlus.

Lietotnes iExaminer un sistēmas iExaminer ar MacroView Plus paredzamā lietojuma vides

ir profesionālas veselības aprūpes vides, piemēram, ģimenes ārsta prakses, slimnīcas, speciālisti, neatliekamā aprūpe, klīnikas un apmācība klīniskajā vidē.



PIEZĪME. Izmantojiet viedtālruni tikai tādā vidē, kas atbilst ražotāja ieteikumiem.

Kontrindikācijas

Lietotnei iExaminer nav kontrindikāciju. Skatiet atbilstīgo Welch Allyn ierīces lietošanas pamācību.

Sistēma iExaminer ar MacroView Plus nav paredzēta acs pārbaudei.

Veiktspējas raksturlielumi

Skatiet atbilstīgo Welch Allyn ierīces lietošanas pamācību.

Simbolu definīcijas

Informāciju par šo simbolu izcelsmi skatiet Welch Allyn simbolu glosārijā:
welchallyn.com/symbolsglossary.



BRĪDINĀJUMS. Paziņojumi ar norādi “Brīdinājums” šajā pamācībā identificē apstākļus vai darbības, kas var izraisīt saslimšanu, ievainojumus vai nāvi. Melnbaltā dokumentā brīdinājuma simboli ir atainoti uz pelēka fona.



UZMANĪBU! Paziņojumi ar norādi “Uzmanību!” šajā pamācībā identificē apstākļus vai darbības, kas var izraisīt aprīkojuma vai cita īpašuma bojājumu vai datu zudumu.



PIEZĪME. Tie sniedz instrukciju skaidrojumus vai noderīgu informāciju par kādu iespēju vai uzvedību.



Skatīt lietošanas pamācību. Lietošanas pamācības eksemplārs ir pieejams šajā tīmekļa vietnē. Drukātu lietošanas pamācības kopiju var pasūtīt no uzņēmuma Hillrom, un tā tiks piegādāta 7 kalendāro dienu laikā.

R_x ONLY Tikai ar recepti vai “Lietošanai licencētam medicīnas darbiniekam vai pēc viņa pasūtījuma”



Atkārtota pasūtījuma numurs



Produkta identifikators





Globālais tirdzniecības identifikācijas numurs





Ražotājs


Brīdinājumi un piesardzības pasākumi


 **BRĪDINĀJUMS.** Sūtot attēlus vai pacientu failus, vienmēr izmantojiet lietotni iExaminer. Nesūtiēt pacienta attēlus no kameras, lai novērstu pacienta attēlu nepareizu saistīšanu. Kameras attēlus izmantojiet tikai apmācībai un neklīniskai lietošanai. Skatiet sadaļu [Ierīces un pacienta dati un drošība](#).


 **BRĪDINĀJUMS.** Šis aprīkojums/sistēma ir paredzēta lietošanai tikai veselības aprūpes speciālistiem. Šis aprīkojums/sistēma var izraisīt radiotraucējumus vai traucēt tuvumā esoša aprīkojuma darbību. Var būt jāveic ietekmi mazinoši pasākumi, piemēram, jāmaina ierīces orientācija vai atrašanās vieta vai jāekranē atrašanās vieta.

 **BRĪDINĀJUMS.** Traumas risks pacientam — magnētiskie lauki. Ievērojiet piesardzību lietojot viedtālruni implantētu ierīču, piemēram, bet ne tikai galvaskausa implantu, regulējamu CFS šuntu un elektrokardiostimulatoru tuvumā.

 **UZMANĪBU!** Novērtējiet Welch Allyn iExaminer attēlus pietiekamā apgaismojumā. Attēla novērtēšana vājā apgaismojumā nav pārbaudīta.

 **UZMANĪBU!** Lai jūsu sistēma nodrošinātu pietiekami kvalitatīvus attēlus, pārbaudiet sistēmas montāžu. Skatiet sadaļu [Montāžas pārbaude](#).

 **PIEZĪME.** Citus brīdinājumus un piesardzības pasākumus skatiet atbilstīgo Welch Allyn ierīču lietošanas pamācībās.

 **PIEZĪME.** Lai iegūtu informāciju par gaismas radītiem apdraudējumiem, kas saistīti ar jūsu ierīci, skatiet atbilstīgo Welch Allyn ierīču lietošanas pamācības.

Atlikušais risks

Šis produkts atbilst saistošo elektromagnētisko traucējumu, mehāniskās drošības, veiktspējas un biosaderības standartu prasībām. Tomēr izstrādājums nevar pilnībā novērst šādu potenciālu pacienta vai lietotāja apdraudējumu:

- Kaitējumu vai ierīces bojājumus, kas saistīti ar elektromagnētisko apdraudējumu.
- Mehāniska apdraudējuma radītu kaitējumu.
- Ierīces, funkciju vai parametru nepieejamības radītu kaitējumu.
- Nepareizas lietošanas, piemēram, nepienācīgas tīrīšanas, radītu kaitējumu un/vai
- Kaitējumu, ko rada ierīces pakļaušana bioloģiskiem rosinātājiem, kas var izraisīt spēcīgu sistēmisku alerģisku reakciju.

Ierīces un pacienta dati un drošība

Welch Allyn iesaka iespējot ierīces līmeņa drošību. Lietotāji ir atbildīgi par viedtālruna drošību.

Lietotne iExaminer ļauj lietotājam koplietot pacienta datus, izmantojot e-pastu un mākonī balstīto krātuvi. Ja pacienta dati tiek koplietoti, izmantojot e-pastu vai mākonī balstīto krātuvi, ir ļoti svarīgi, lai lietotājs koplietotu datus tikai ar citiem pilnvarotiem lietotājiem atbilstoši HIPAA noteikumiem.

Par pacienta datu aizsardzību ir atbildīgs tikai lietotājs. Pirms pacienta ierakstu nosūtīšanas lietotājiem ir jāapstiprina pacienta identitāte.

Lai droši koplietotu pacienta datus, izmantojot e-pastu, lietotājam jānodrošina, ka e-pasta lietotne ir konfigurēta drošai saziņai ar e-pasta serveri, izmantojot transporta slāņa drošību (TLS). Transporta slāņa drošība (TLS) ir kriptogrāfijas protokoli, kas izstrādāti, lai nodrošinātu sakaru aizsardzību datortīklā. TLS protokola primārais mērķis ir privātuma un datu integritātes nodrošināšana starp divām vai vairākām datora sakaru lietotnēm.

Iestatot e-pasta kontu (piemēram, IMAP, POP), lietotājam jāatlasa drošības metode, kas izmanto TLS/SSL. iOS noklusējuma pasta lietotne Mail, ja tiek lietota kopā ar noklusējuma iCloud e-pasta serveri, jau ir nodrošināta ar TLS. Android noklusējuma pasta lietotne Gmail, ja tiek lietota kopā ar noklusējuma Gmail serveri, jau ir nodrošināta ar TLS.

Nosūtot pacienta datus uz mākonī balstītu krātuvi, ir ļoti svarīgi, lai mākoņkrātuves metode tiktu nodrošināta, izmantojot TLS. Operētājsistēmā iOS iCloud Drive tiek nodrošināts, izmantojot TLS. Operētājsistēmā Android Google disks un Google fotoattēli tiek aizsargāti, izmantojot TLS.

Lietošana pirmo reizi

Apmeklējiet vietni hillrom.com un noskatieties video par iExaminer Pro.

Pārliecinieties, vai esat izpildījis turpmāk minēto.

1. Atlasiet viedtālruni, kas atbilst kritērijiem [Norādījumi par viedtālruna un korpusa izvēli](#).
2. Lejupielādējiet lietotni iExaminer no App Store® vai Google Play™ veikala.
3. Ja jaunināšana veikta no iepriekšējās versijas, kurā saglabāti attēli, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
4. Atlasiet lietošanas režīmu.
 - Darbam ar pacientiem ir paredzēts klīniskais režīms. Izmeklējuma dati ir jānosūta no lietotnes pēc katra izmeklējuma. Tālrunī izmeklējuma dati netiek saglabāti.
 - Apmācību režīms ir paredzēts tikai mācību nolūkiem. Atlasot šo režīmu, prakses izmeklējumus var glabāt lietotāja noteiktu laiku no 30 līdz 180 dienām, bet pēc tam dati no lietotnes ir jāizdzēš. Šajā režīmā nav jāsavienā individuāli identificējami pacienta dati vai personas dati. Datu saglabāšanas noklusējuma periods prakses izmeklējumiem ir 30 dienas.
5. Piekrist noteikumiem un nosacījumiem.
6. Iestatiet lietotnes un viedtālruna drošību. Pārskatiet konfidencialitātes ieteikumus. Skatiet sadaļu [Ierīces un pacienta dati un drošība](#).

7. Sākotnējo iestatīšanu skatiet **WELCH ALLYN IEXAMINER SMARTBRACKET MONTĀŽAS INSTRUKCIJĀS** (iekļautas komplektā). Pārliedcinieties, vai pietiek vietas, lai pilnībā piestiprinātu SmartBracket līmvielu un piestiprinātu SmartClip pie gludās, stingrās un plakanās korpusa aizmugures.
8. Pievienojiet Welch Allyn ierīci SmartBracket.
9. Pārbaudiet sistēmas montāžu, izmantojot iExaminer izšķirtspējas testa karti (iekļauta komplektā). Skatiet sadaļu [Montāžas pārbaude](#).
10. Lai veiktu izmeklējumu, skatiet video un citus mācību materiālus vietnē hillrom.com



PIEZĪME. iExaminer 3.1.x ir saderīgs ar iOS 11 un jaunāku versiju, kā arī Android 7.0 un jaunāku versiju.



PIEZĪME. Lai pārslēgtu režīmus, atinstalējiet un atkārtoti instalējiet lietotni. Atinstalējot lietotni, tiks izdzēsti visi saglabātie dati.

Norādījumi par viedtālruņa un korpusa izvēli

Viedtālruņa korpuss

Korpusa virsmai jābūt gludai, plakanai, bez gumijas (piemēram, bez silikona apvalka) un bez izvirzījumiem. Dažas funkcijas (piemēram, pirkstu nospiedumu sensors un citas kameras) kavē SmartClip instalēšanu. Skatiet **WELCH ALLYN IEXAMINER SMARTBRACKET MONTĀŽAS INSTRUKCIJAS** (iekļautas komplektā).

Viedtālruņa kritēriji

Izmantojiet viedtālruni, kas atbilst tālāk minētajiem kritērijiem.

- Izmērs — viedtālruņa un korpusa kopējais izmērs ir mazāks par 165 mm garumā, 85 mm platumā un 13 mm biezumā.
- Svars — viedtālruņa un korpusa kopsvars ir mazāks par 280 g.
- Optika — pieņemamas gandrīz visas viedtālruņu kameras, kuru izšķirtspēja lielāka vai vienāda ar 8 MP. Informāciju par to, kā pārbaudīt jūsu sistēmu, skatiet sadaļā [Montāžas pārbaude](#).
- Displejs — krāsu displejs — ekrāna izmērs ≥ 101 mm
- Aparatūra — ≥ 500 MB iekšējā atmiņa
- Programmatūra — atbalsta JPEG attēlus un ir saderīgs ar iOS 11 un jaunāku versiju vai Android 7.0 un jaunāku versiju.
- Elektrība
 - o Viedtālruņa izstarotajām emisijām ir jāatbilst Federālo noteikumu kodeksa 47. nodaļas 15. daļai (vai līdzvērtīgai).
 - o Viedtālruņa induktīvajai uzlādei jābūt Qi sertificētai (vai līdzvērtīgai).
 - o Viedtālruņa uzlādei jāatbilst IEC/UL 60950-1 (vai līdzvērtīgai).

Montāžas pārbaude


Pēc sistēmas samontēšanas novietojiet **IEXAMINER IZŠĶIRTSPĒJAS TESTA KARTI** (iekļauta komplektā) uz līdzenas virsmas. Atveriet lietotni iExaminer un pēc tam veiciet tālāk norādītās darbības.

1. Sāciet izmeklējumu lietotnē iExaminer.
2. Viedtālrunī tuviniet, līdz skata lauks ekrānā ir iespējami liels.
3. Turiet ierīci tā, lai viedtālruna ekrāns būtu paralēli testa kartei attālumā, kur atbilstīgais mērķa aplis ir skata lauka malā.



PIEZĪME. Uzgalim jābūt piestiprinātam.

4. Pieskarieties ekrānam, lai fokusētu uz mērķa centru.
5. Beidziet izmeklējumu.
6. Pārskatiet tvertos attēlus un atlasiet labāko(-s).
7. Apstipriniet visus 5 izšķirtspējas mērķus ar "Atbilst". Izmantojiet piemērus, lai noteiktu atšķirību starp "Atbilst" un "Neatbilst" izšķirtspējas mērķi. Katram izšķirtspējas mērķim jābūt 3 horizontālām un 3 vertikālām līnijām.

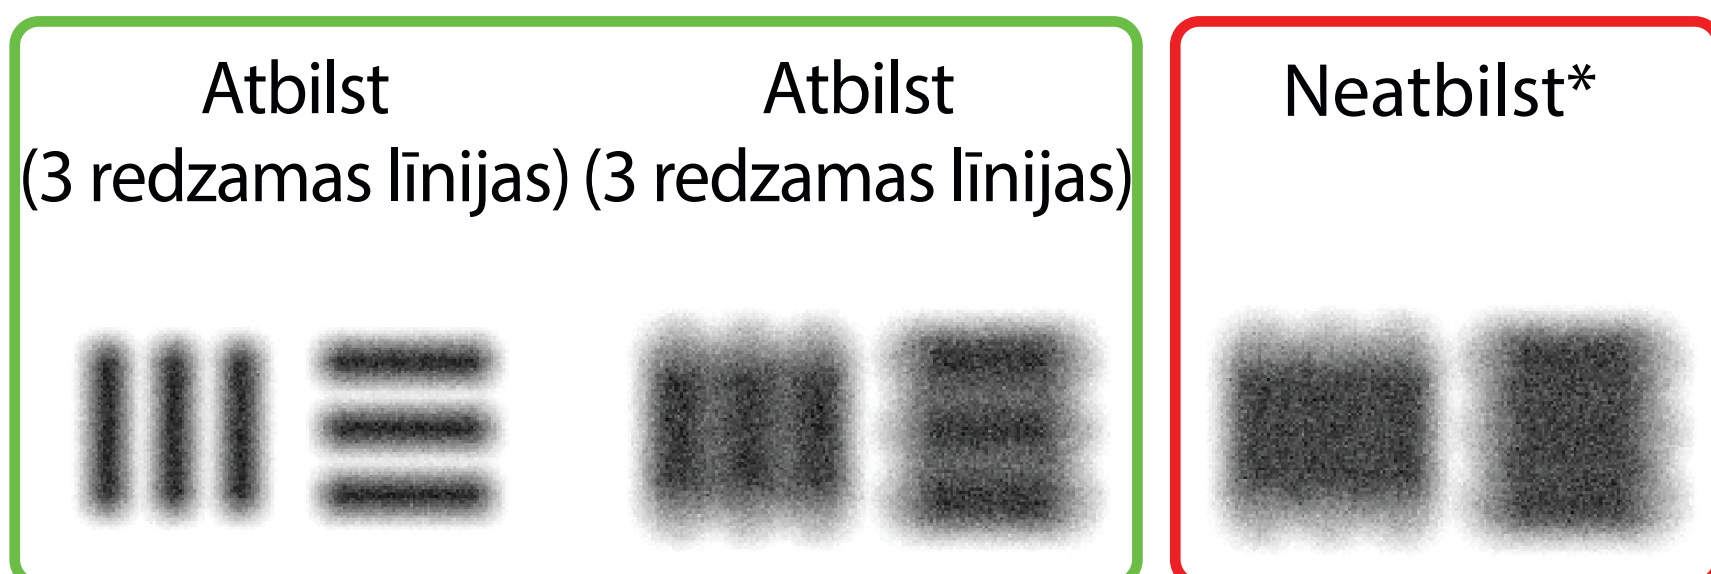

*Lai saņemtu palīdzību, sazinieties ar Hillrom tehnisko atbalstu vai apmeklējiet vietni hillrom.com

Lietotnes funkciju izmantošana



Izmantojiet zemāk norādītās saites, lai pārietu uz darbību vai izlasītu ierīces operētājsistēmas visas pamācības.

Mācību režīms		Klīniskais režīms	
iOS	Android	iOS	Android
Iestatījumu modificēšana (iOS)	Iestatījumu modificēšana (Android)	Iestatījumu modificēšana (iOS)	Iestatījumu modificēšana (Android)
Paroles iestatīšana (iOS)	Paroles iestatīšana (Android)	Nav pieejams	Nav pieejams
Paroles atiestatīšana (iOS)	Paroles atiestatīšana (Android)	Nav pieejams	Nav pieejams
Pieteikšanās (iOS)	Pieteikšanās (Android)	Nav pieejams	Nav pieejams
Skatīt izmeklējumu, kuram beidzies derīguma termiņš (iOS)	Skatīt izmeklējumu, kuram beidzies derīguma termiņš (Android)	Nav pieejams	Nav pieejams
Dzēst izmeklējumus, kuriem beidzies derīguma termiņš (iOS)	Dzēst izmeklējumus, kuriem beidzies derīguma termiņš (Android)	Nav pieejams	Nav pieejams
Skatīt izmeklējumus, kuriem drīz beigsies derīguma termiņš (iOS)	Skatīt izmeklējumus, kuriem drīz beigsies derīguma termiņš (Android)	Nav pieejams	Nav pieejams
Izmeklējuma pievienošana (iOS)	Izmeklējuma pievienošana (Android)	Sākt jaunu izmeklējumu (iOS)	Sākt jaunu izmeklējumu (Android)
Attēlu tveršana (iOS)	Attēlu tveršana (Android)	Attēlu tveršana (iOS)	Attēlu tveršana (Android)
Attēlu atlasīšana (iOS)	Attēlu atlasīšana (Android)	Attēlu atlasīšana (iOS)	Attēlu atlasīšana (Android)
Atlasīto attēlu skatīšana (iOS)	Atlasītā attēla skatīšana (Android)	Atlasīto attēlu skatīšana (iOS)	Atlasītā attēla skatīšana (Android)
Attēlu filtrēšana, pārvietošana un dzēšana (iOS)	Attēlu filtrēšana, pārvietošana un dzēšana (Android)	Attēlu filtrēšana, pārvietošana un dzēšana (iOS)	Attēlu filtrēšana, pārvietošana un dzēšana (Android)
Attēla koplietošana (iOS)	Attēla koplietošana (Android)	Attēla koplietošana (iOS)	Attēla koplietošana (Android)
Izmeklējuma saglabāšana (iOS)	Izmeklējuma saglabāšana (Android)	Nav pieejams	Nav pieejams
Saglabāta izmeklējuma atjaunināšana (iOS)	Saglabāta izmeklējuma atjaunināšana (Android)	Nav pieejams	Nav pieejams
Izmeklējuma koplietošana (iOS)	Izmeklējuma koplietošana (Android)	Izmeklējuma koplietošana (iOS)	Izmeklējuma koplietošana (Android)
Izmeklējuma dzēšana (iOS)	Izmeklējuma dzēšana (Android)	Izmeklējuma atmešana (iOS)	Izmeklējuma atmešana (Android)

Saistībā ar lietotnes izmantošanu atveriet sadaļu [iOS norādes](#)

Saistībā ar lietotnes izmantošanu atveriet sadaļu [Android norādes](#)

iOS norādes



PIEZĪME. Attēli tiek rādīti ilustratīvos nolūkos.




PIEZĪME. Izmeklējuma ekrānā tiek atvērts klīniskais režīms.

Ekrāna elementi (iOS)

Attiecas uz: mācību režīms, klīniskais režīms

Ikona Definīcija




Koplietot




Dzēst



Filtrēt



Pievienot



Pārvietot


Pāriet uz sarakstu *Lietotnes funkciju izmantošana*

Iestatījumu modificēšana (iOS)

Attiecas uz: mācību režīms, klīniskais režīms

Modificējiet iestatījumus, piemēram, attēla izšķirtspēju vai datu saglabāšanas periodu. Daži iestatījumi var būt pieejami tikai noteiktā režīmā.

1. Atveriet ierīces iestatījumus.
2. Ritiniet līdz lietotnei iExaminer Pro.
3. Atveriet lietotnes iestatījumus.

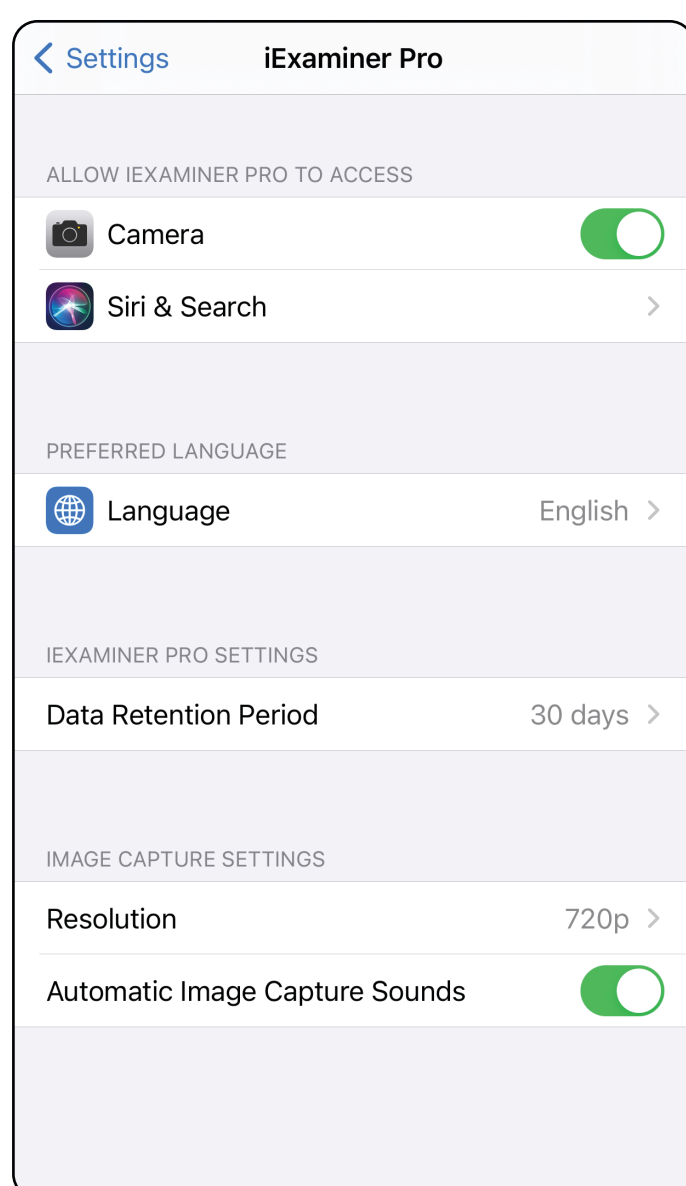

4. Modificējiet iestatījumu opcijas. [Montāžas pārbaude](#) vēlreiz, ja maināt attēla izšķirtspēju.
5. Lai saglabātu iestatījumus, pieskarieties atpakaļvērstajai bultiņai augšējā kreisajā stūrī.
6. Atgriezieties lietotnē.

Pāriet uz sarakstu *Lietotnes funkciju izmantošana*

Autentifikācija (iOS)

Attiecas uz: mācību režīms

Autentifikācijas ekrānā pieejamās darbības


- [Paroles iestatīšana \(iOS\)](#)
- [Paroles atiestatīšana \(iOS\)](#)
- [Pieteikšanās \(iOS\)](#)

Paroles iestatīšana (iOS)

Attiecas uz: mācību režīms

Iestatiet paroli, kas atbilst validācijas kritērijiem.

1. Autentifikācijas ekrānā divreiz ievadiet jauno paroli.
2. Pieskarieties pie **Set** (lestatīt).

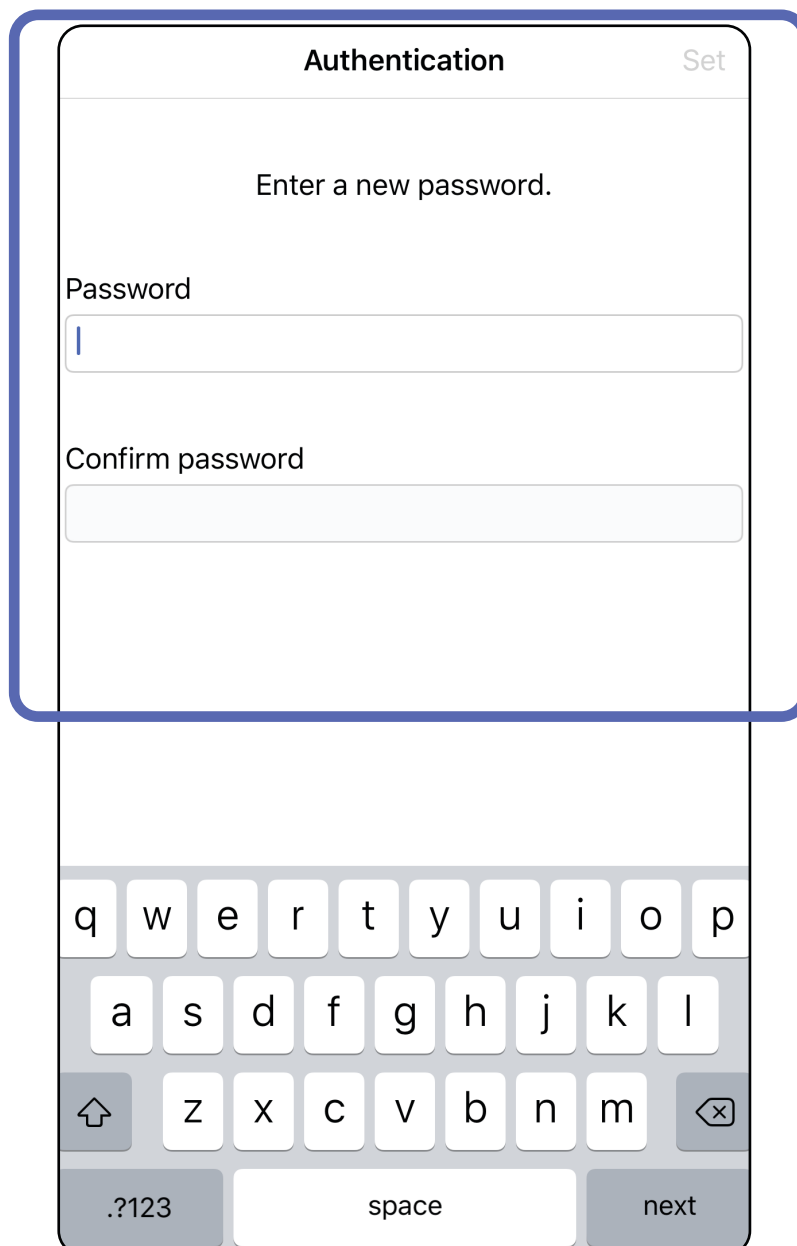

Pāriet uz sarakstu *Lietotnes funkciju izmantošana*


Paroles atiestatīšana (iOS)

Attiecas uz: mācību režīms

1. Lai atiestatītu paroli, autentifikācijas ekrānā ieskarieties pie **Reset** (Atiestatīt).
2. Divreiz ievadiet jauno paroli.
3. Pieskarieties pie **Reset** (Atiestatīt), lai apstiprinātu paroles atiestatīšanu. Šo darbību nevar atsaukt.



PIEZĪME. Atiestatot paroli, no lietotnes tiek dzēsti visi esošie izmeklējumi.

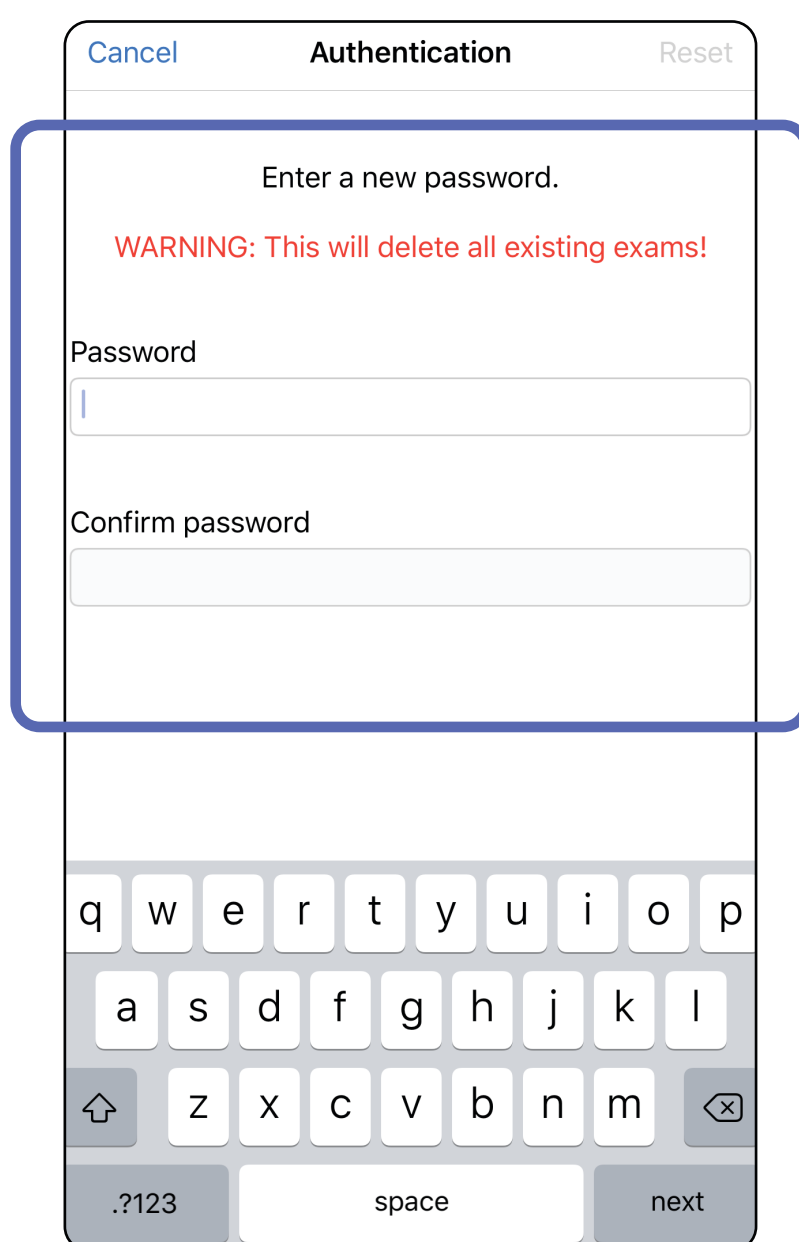


Pāriet uz sarakstu *Lietotnes funkciju izmantošana*

Pieteikšanās (iOS)

Attiecas uz: mācību režīms

1. Atveriet lietotni.
2. Autentifikācijas ekrānā ievadiet savu paroli.
3. Pieskarieties pie **Login** (Pieteikties).

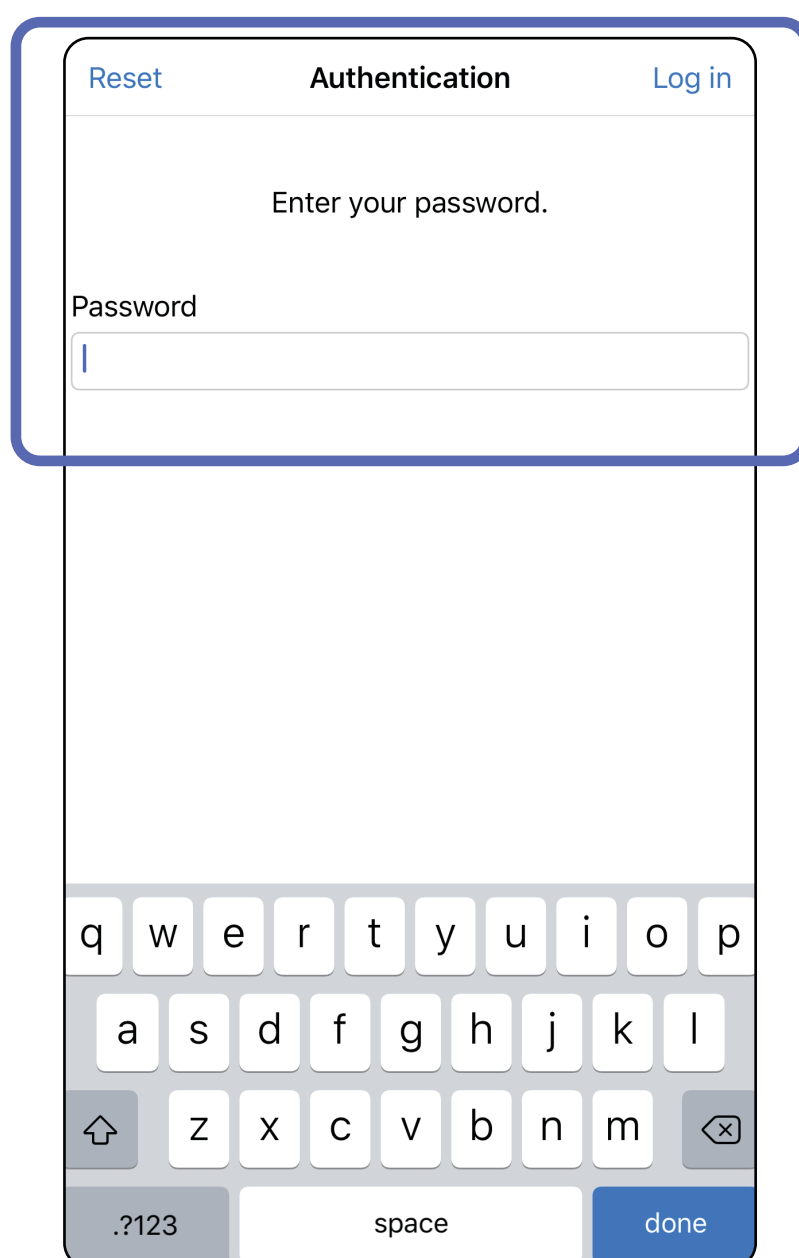


Pāriet uz sarakstu *Lietotnes funkciju izmantošana*

Izmeklējumi, kuriem beidzies derīguma termiņš (iOS)


Attiecas uz: mācību režīms

Izmeklējumam ir beidzies derīguma termiņš, ja tiek pārsniegts datu glabāšanas periods. Kad lietotne ir atvērta mācību režīmā un ir izmeklējumi, kuriem beidzies derīguma termiņš, tie ir jāizdzēš, lai turpinātu izmantot lietotni. Ja kādam izmeklējumam ir beidzies derīguma termiņš, tiks parādīts brīdinājums.

1. Pieskarieties pie **OK** (Labi), lai apstiprinātu brīdinājumu.

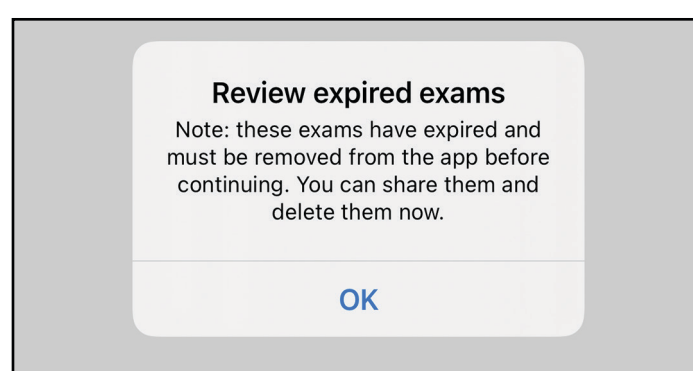

2. Pārskatiet parādīto sarakstu ar izmeklējumiem, kuriem beidzies derīguma termiņš.

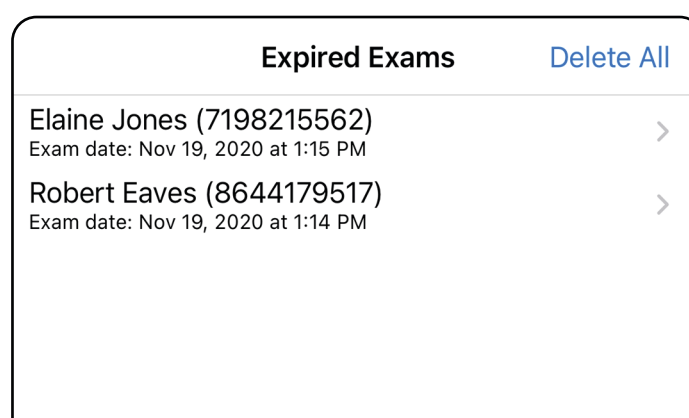


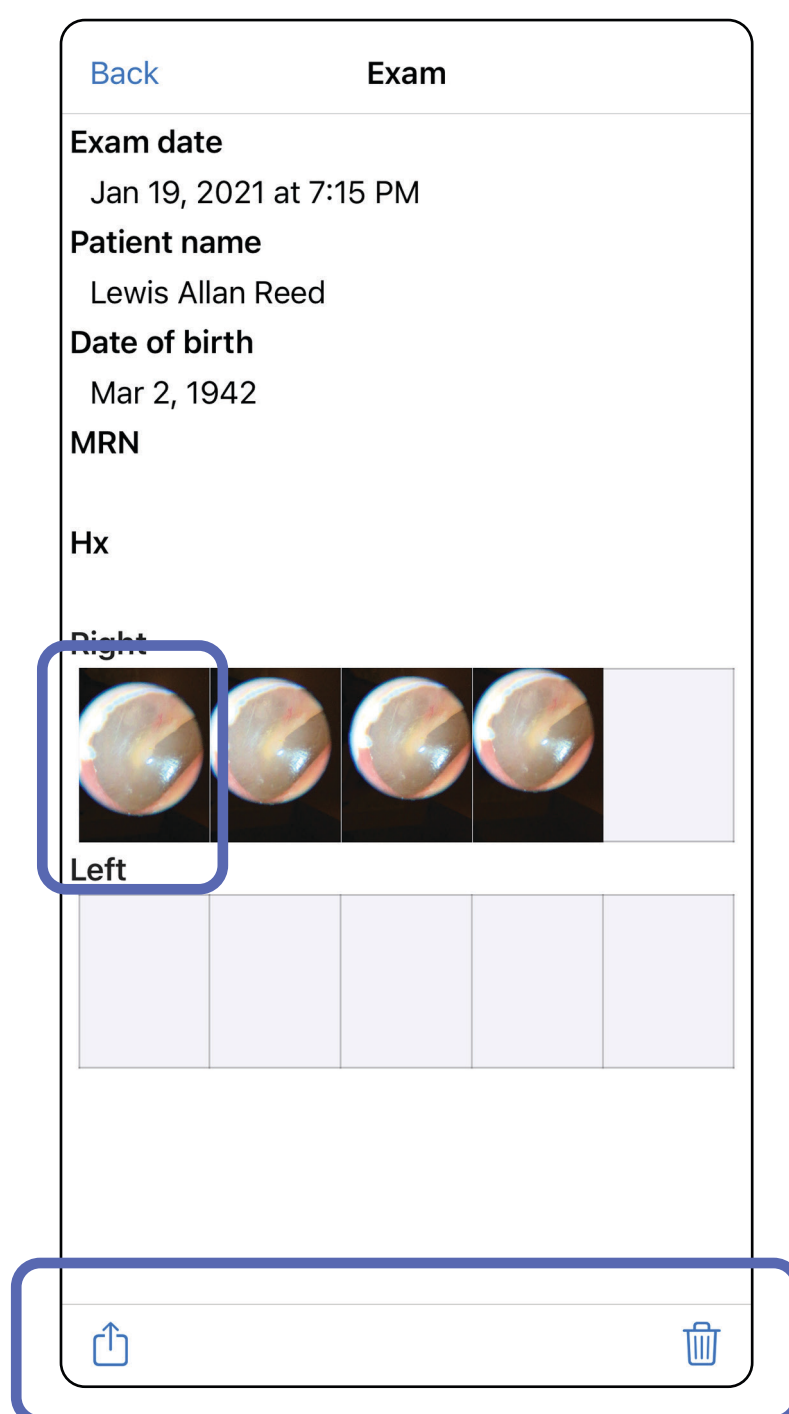
3. [Skatīt izmeklējumu, kuram beidzies derīguma termiņš \(iOS\)](#) kur var koplietot vai dzēst izmeklējumu un koplietot izmeklējuma attēlus vai [Dzēst izmeklējumus, kuriem beidzies derīguma termiņš \(iOS\)](#).

Skatīt izmeklējumu, kuram beidzies derīguma termiņš (iOS)

Attiecas uz: mācību režīms

Pieskarieties sarakstā esošam izmeklējumam, kuram beidzies derīguma termiņš. Izmeklējums, kuram beidzies derīguma termiņš, ir tikai lasāms un tas ir jāizdzēš pirms cita izmeklējuma sākšanas. Pirms dzēst izmeklējumu, kuram beidzies derīguma termiņš, varat:

- Pieskarieties attēlam, lai [Skatīt attēlu izmeklējumam, kuram beidzies derīguma termiņš \(iOS\)](#).
- Pieskarieties , lai [Izmeklējuma koplietošana \(iOS\)](#).





- Skatiet sadaļu [Dzēst izmeklējumus, kuriem beidzies derīguma termiņš \(iOS\)](#).

Skatīt attēlu izmeklējumam, kuram beidzies derīguma termiņš (iOS)

Attiecas uz: mācību režīms

Izmeklējuma, kuram beidzies derīguma termiņš, ekrānā pieskarieties attēlam, lai to atvērtu.

- Pieskarieties pie , lai [Attēla koplietošana \(iOS\)](#) izmeklējumā, kuram beidzies derīguma termiņš.
- Pieskarieties pie , lai [Lietot filtru attēlam \(iOS\)](#) izmeklējumā, kuram beidzies derīguma termiņš.




Pāriet uz sarakstu *Lietotnes funkciju izmantošana*

Dzēst izmeklējumus, kuriem beidzies derīguma termiņš (iOS)

Attiecas uz: mācību režīms

Lai dzēstu visus izmeklējumus, kuriem beidzies derīguma termiņš:


1. Pieskarieties pie **Delete All** (Dzēst visu).
2. Pieskarieties pie OK (Labi), lai apstiprinātu dzēšanu izmeklējumiem, kuriem beidzies derīguma termiņš.

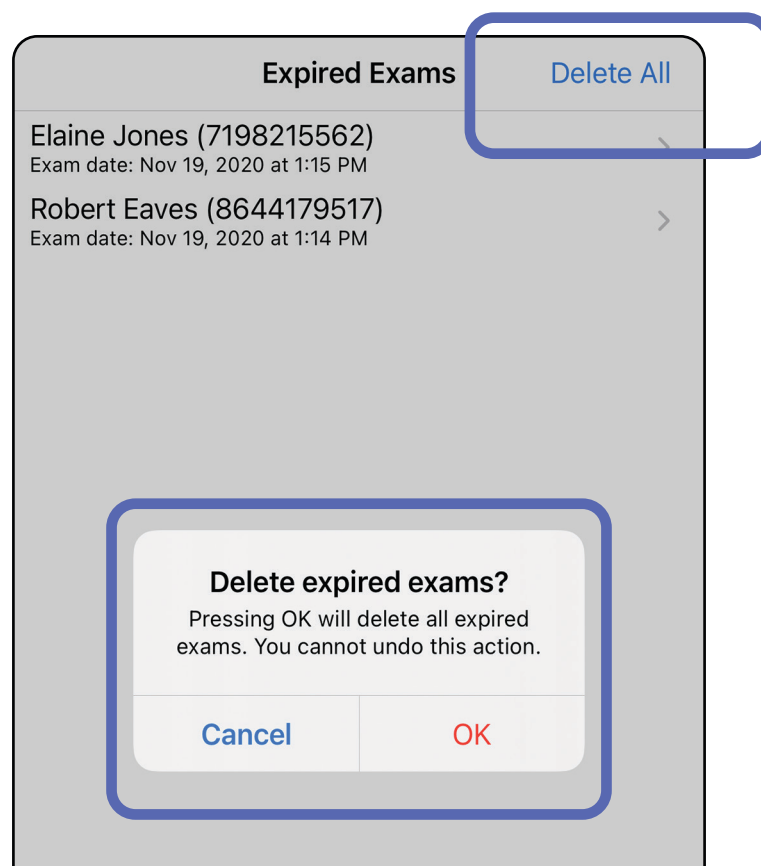


Lai dzēstu izmeklējumu, kuram ir beidzies derīguma termiņš, ir 2 izvēles iespējas.

1. opcija — pavilkt, lai dzēstu.


1. Pavilkt pa kreisi uz izmeklējuma nosaukuma, kuram ir beidzies derīguma termiņš.
2. Pieskarieties pie **Delete** (Dzēst), lai apstiprinātu.

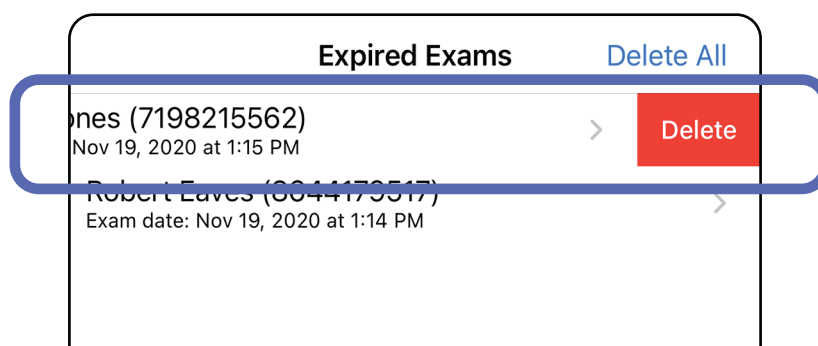

3. Uznirstošajā logā, pieskarieties pie **OK** (Labi), lai apstiprinātu.

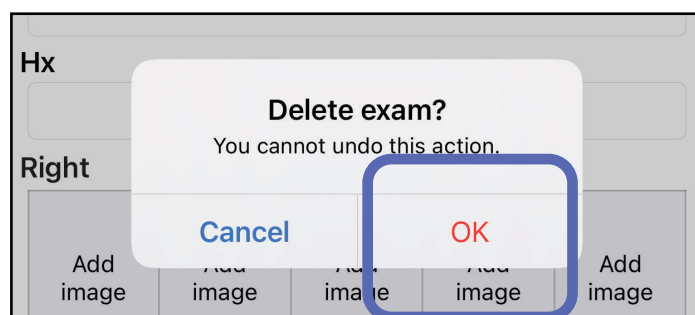

2. opcija — skatiet izmeklējumu, kuram ir beidzies derīguma termiņš, tad pieskarieties pie .

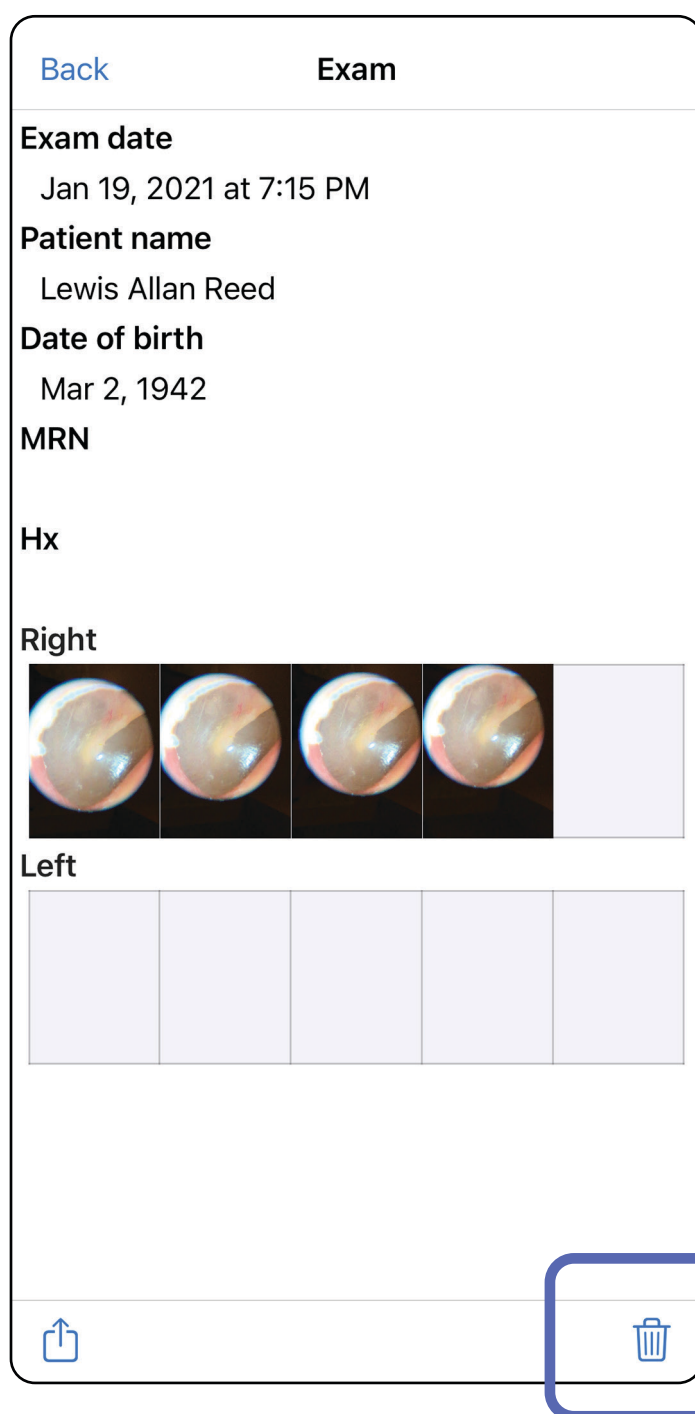


Pāriet uz sarakstu *Lietotnes funkciju izmantošana*

Izmeklējumi, kuriem drīz beigsies derīguma termiņš (iOS)

Attiecas uz: mācību režīms

Ja ir izmeklējumi, kuriem drīz beigsies derīguma termiņš, parādās dialoglodziņš "Izmeklējumi, kuriem drīz beigsies derīguma termiņš".


Pieskarieties pie **OK** (Labi), pārskatītu izmeklējumus, kuriem drīz beigsies derīguma termiņš.

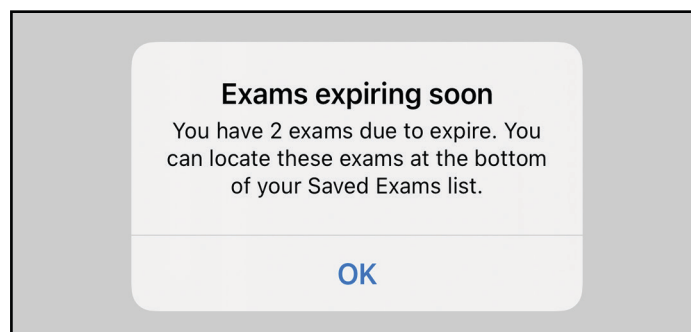

Skatīt izmeklējumus, kuriem drīz beigsies derīguma termiņš (iOS)

Attiecas uz: mācību režīms


Kamēr nav beidzies izmeklējuma derīguma termiņš, nekādas darbības nav jāveic.

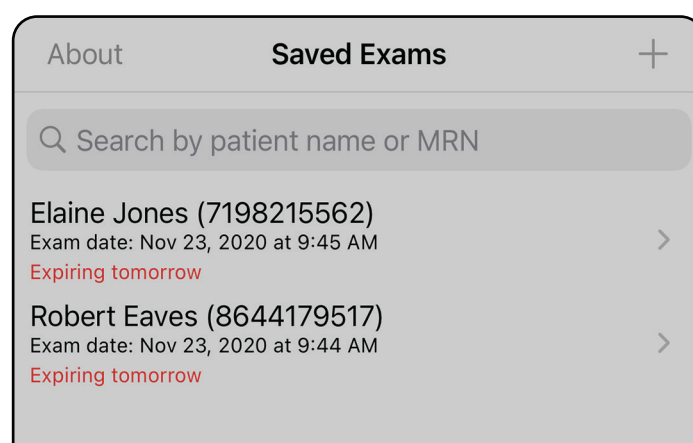

Izmeklējuma pievienošana (iOS)

Attiecas uz: mācību režīms

1. Pieskarieties pie **+**, lai pievienotu jaunu izmeklējumu.
2. Skatiet sadaļu [Attēlu tveršana \(iOS\)](#).

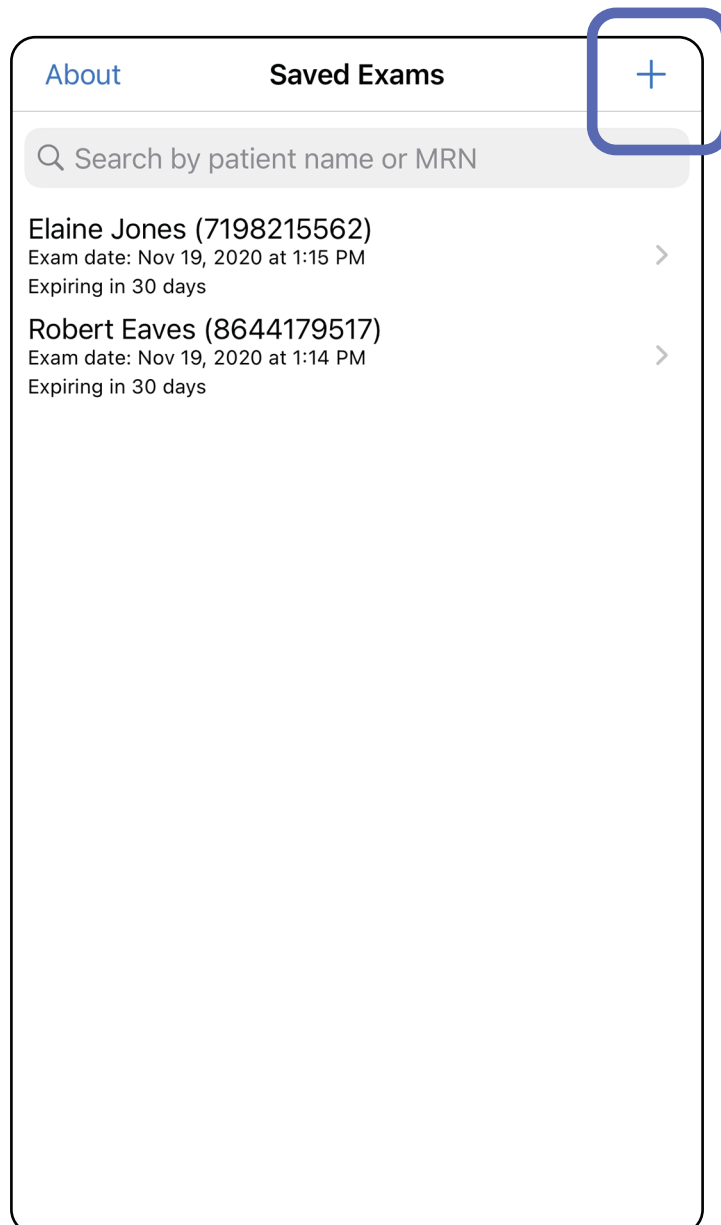

Attēlu tveršana (iOS)

Attiecas uz: mācību režīms, klīniskais režīms

1. Novietojiet ierīci izvēlētajā pusē. Lai veiktu izmeklējumu, skatiet video un citus mācību materiālus vietnē hillrom.com
2. Pieskarieties pie **Add image** (Pievienot attēlu), lai tvertu attēlus labajai un kreisajai pusei.

Exam

Exam date
Mar 24, 2020 at 9:59 AM

Patient name
Required

Date of birth

MRN
Required

Hx

Right


Add image Add image Add image Add image Add image

Left


Add image Add image Add image Add image Add image

Share icon

3. Ja ir iepriekšējs ieraksts, uznirstošajā izvēlnē atlasiet opciju, lai sāktu **New recording** (Jauns ieraksts) vai atlasītu attēlus no **Previous recording** (Iepriekšējais ieraksts). Skatiet sadaļu [Attēlu atlasīšana \(iOS\)](#).

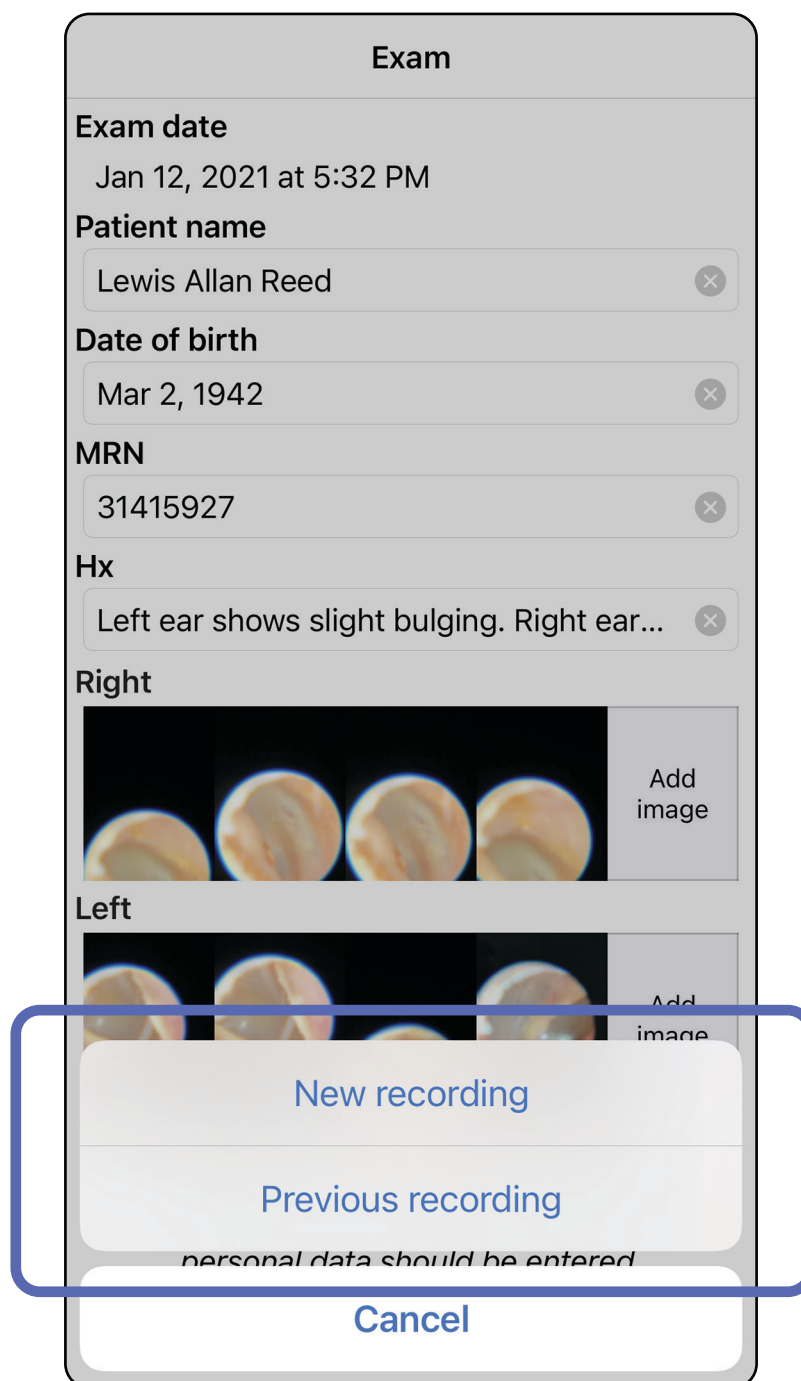

Ja nav iepriekšēja ieraksta, ierakstīšana tiek sākota un apturēta automātiski. Skatiet sadaļu [Attēlu atlasīšana \(iOS\)](#).

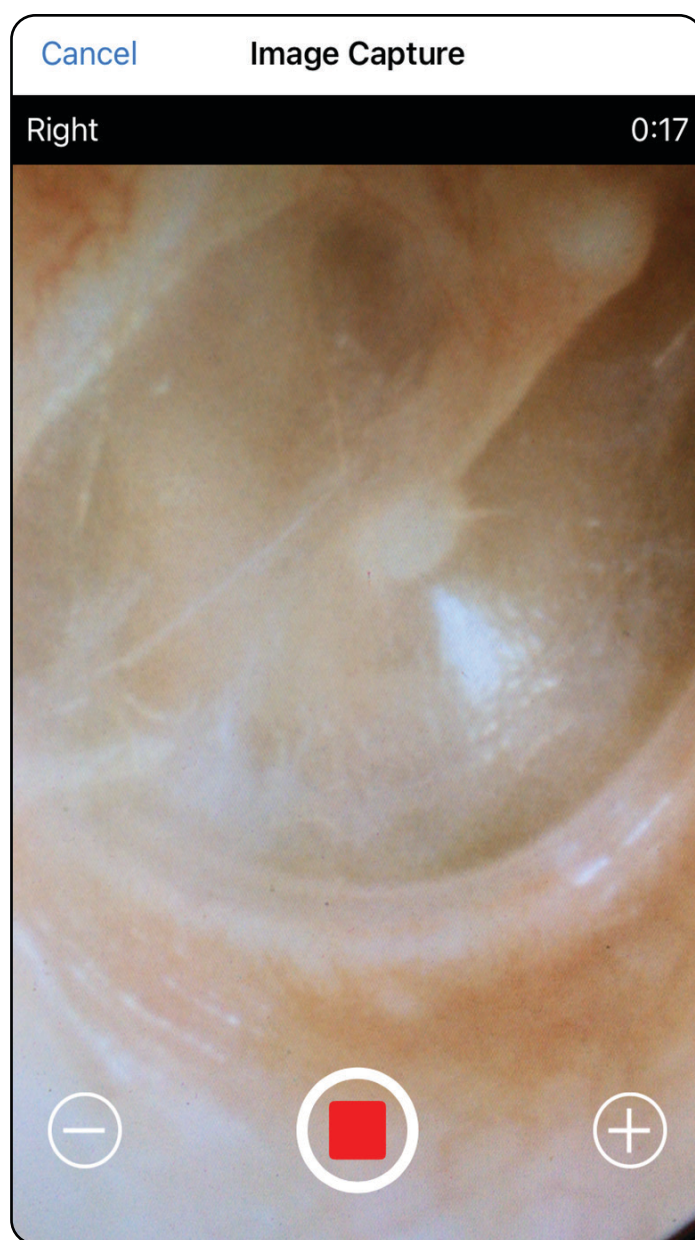

Pāriet uz sarakstu *Lietotnes funkciju izmantošana*

Attēlu atlasīšana (iOS)

Attiecas uz: mācību režīms, klīniskais režīms

1. Atlasiet attēlus, ko vēlaties saglabāt, izmantojot slīdni apakšā, un pavelciet pa kreisi vai pa labi uz attēla, lai tos atlasītu.
2. Pieskarieties pie **+** katram attēlam, ko vēlaties saglabāt.
3. Pieskarieties pie **Done** (Pabeigts).



PIEZĪME. Izmeklējumā var saglabāt ne vairāk kā 5 katras puses attēlus.



PIEZĪME. Bultiņa attēla augšējā labajā stūrī norāda, kurš virziens ir tvertā attēla augšpuse.



Pāriet uz sarakstu *Lietotnes funkciju izmantošana*


Atlasīto attēlu skatīšana (iOS)

Attiecas uz: mācību režīms, klīniskais režīms

1. Izmeklējumu ekrānā pieskarieties attēlam.
2. Atlasītā attēla ekrānā pārvelciet pa kreisi vai pa labi, lai ritinātu caur visiem abu pušu attēliem.



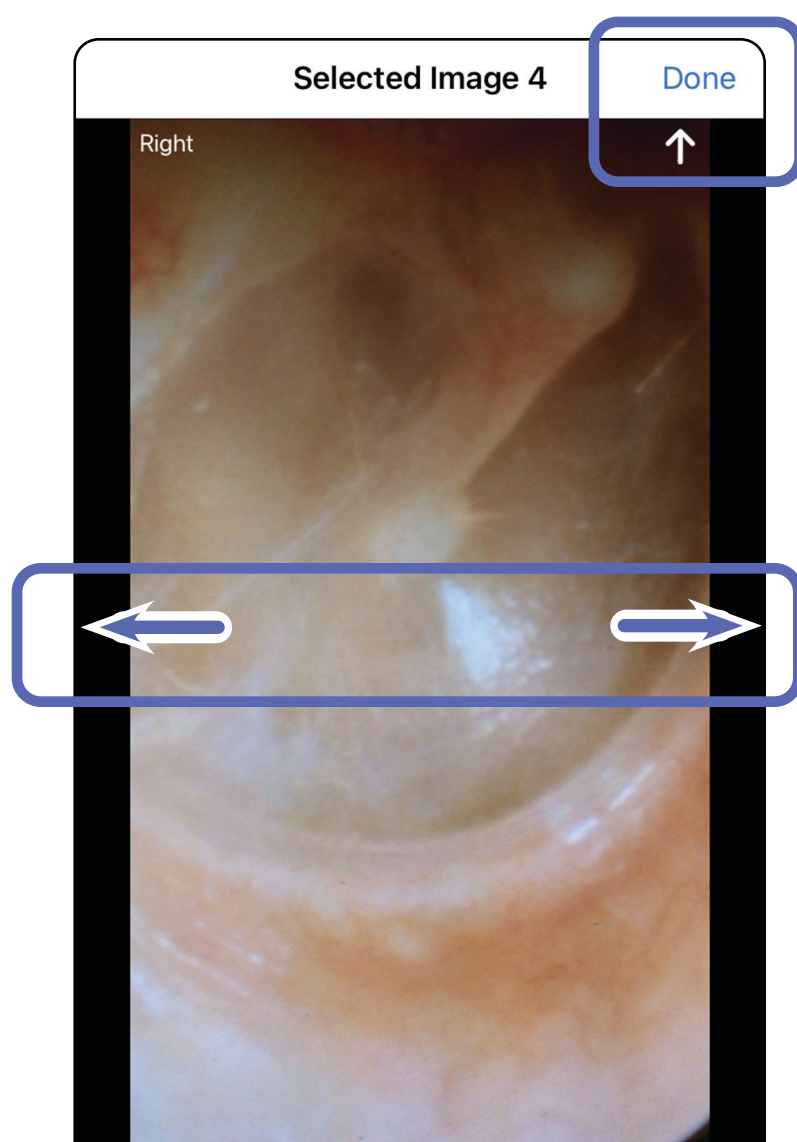


PIEZĪME. Bultiņa attēla augšējā labajā stūrī norāda, kurš virziens ir tvertā attēla augšpuse.




Attēlu filtrēšana, pārvietošana un dzēšana (iOS)

Attiecas uz: mācību režīms, klīniskais režīms

Izmeklējumu ekrānā pieskarieties attēlam, lai to atvērtu.

- Pieskarieties pie , lai filtrētu. Filtri tiek lietoti tikai pašreizējam attēlam un tad, kad šis attēls tiek koplietots. Oriģinālie nefiltrētie attēli tiek saglabāti.
- Pieskarieties pie , lai pārvietotu attēlu uz otru pusi (*nav pieejams izmeklējumiem, kuriem beidzies derīguma termiņš*). Šī funkcija ir noderīga, ja sākot attēlu tveršanu, ir izvēlēta nepareizā puse.
- Pieskarieties pie , lai dzēstu attēlu, tad apstipriniet dzēšanu (*nav pieejams izmeklējumiem, kuriem beidzies derīguma termiņš*).

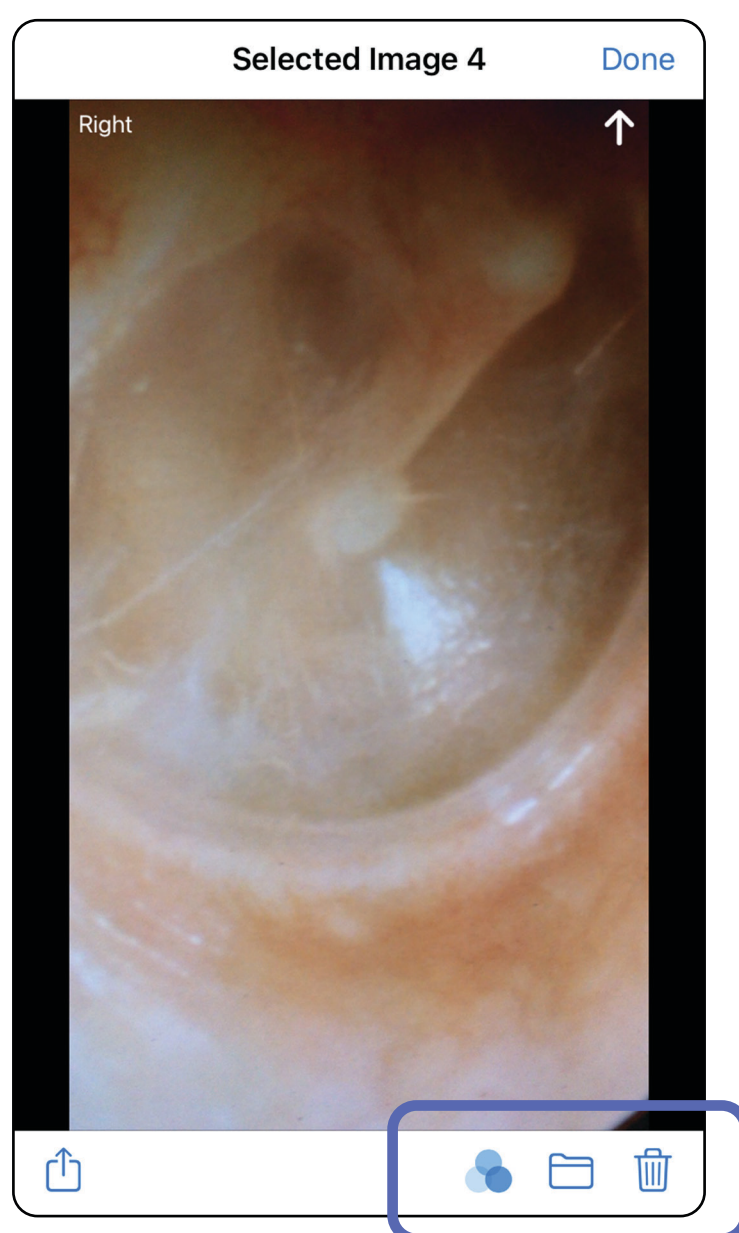

Pāriet uz sarakstu *Lietotnes funkciju izmantošana*

Izmeklējuma saglabāšana (iOS)

Attiecas uz: mācību režīms

1. Pievienojiet informāciju par pacientu.
2. Pieskarieties pie **Save** (Saglabāt).



PIEZĪME. Lai saglabātu izmeklējumu, attēli nav nepieciešami. Papildinformāciju par pacientu var pievienot pirms vai pēc attēlu atlasīšanas.




PIEZĪME. Izmeklējumu var saglabāt tikai pēc nepieciešamās informācijas ievadišanas.

The screenshot displays the 'Exam' screen in the iExaminer Pro app. At the top, there are three buttons: 'Cancel', 'Exam', and 'Save'. The 'Save' button is highlighted with a blue box. Below the buttons, the 'Exam date' is set to 'Jan 1, 2021 at 10:19 AM'. The 'Patient name' field contains 'Declan McManus' and has a close button (x). The 'Date of birth' field contains 'Aug 25, 1954' and also has a close button (x). There are empty input fields for 'MRN' and 'Hx'. Below these fields, there are sections for 'Right' and 'Left' views. The 'Right' view shows two small images of a patient's mouth and three 'Add image' buttons. The 'Left' view shows five 'Add image' buttons. At the bottom left, there is a share icon.

Saglabāta izmeklējuma atjaunināšana (iOS)


Attiecas uz: mācību režīms

1. Ja vēlaties rediģēt izmeklējumu, pieskarieties nepieciešamajam izmeklējuma nosaukumam, lai atvērtu izmeklējumu.

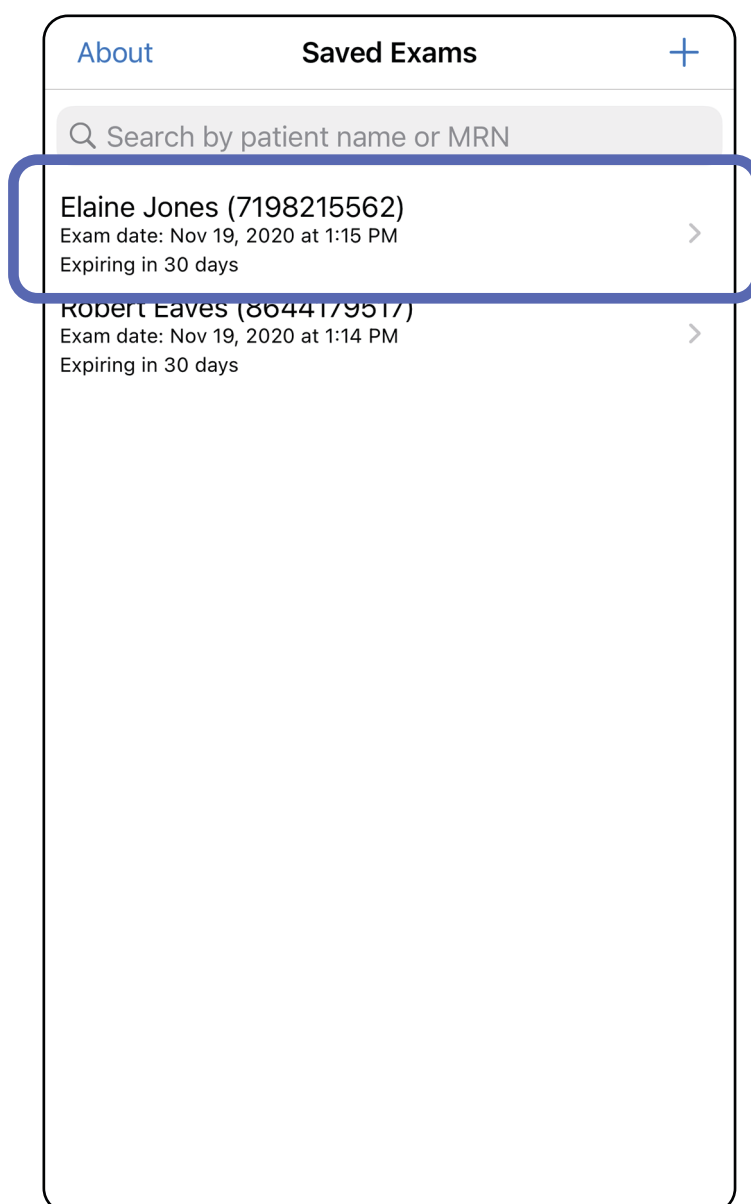

Pāriet uz sarakstu *Lietotnes funkciju izmantošana*

2. Izmeklējuma ekrānā pieskarieties laukam, ko vēlaties atjaunināt.
3. Ievadiet pacienta informāciju.
 - a. Izmantojiet uznirstošo tastatūru vai cipartastatūru, lai ievadītu pacienta vārdu vai MRN (medicīniskās dokumentācijas numuru).
 - b. Izmantojiet uznirstošo kalendāru, lai atlasītu dzimšanas datumu.

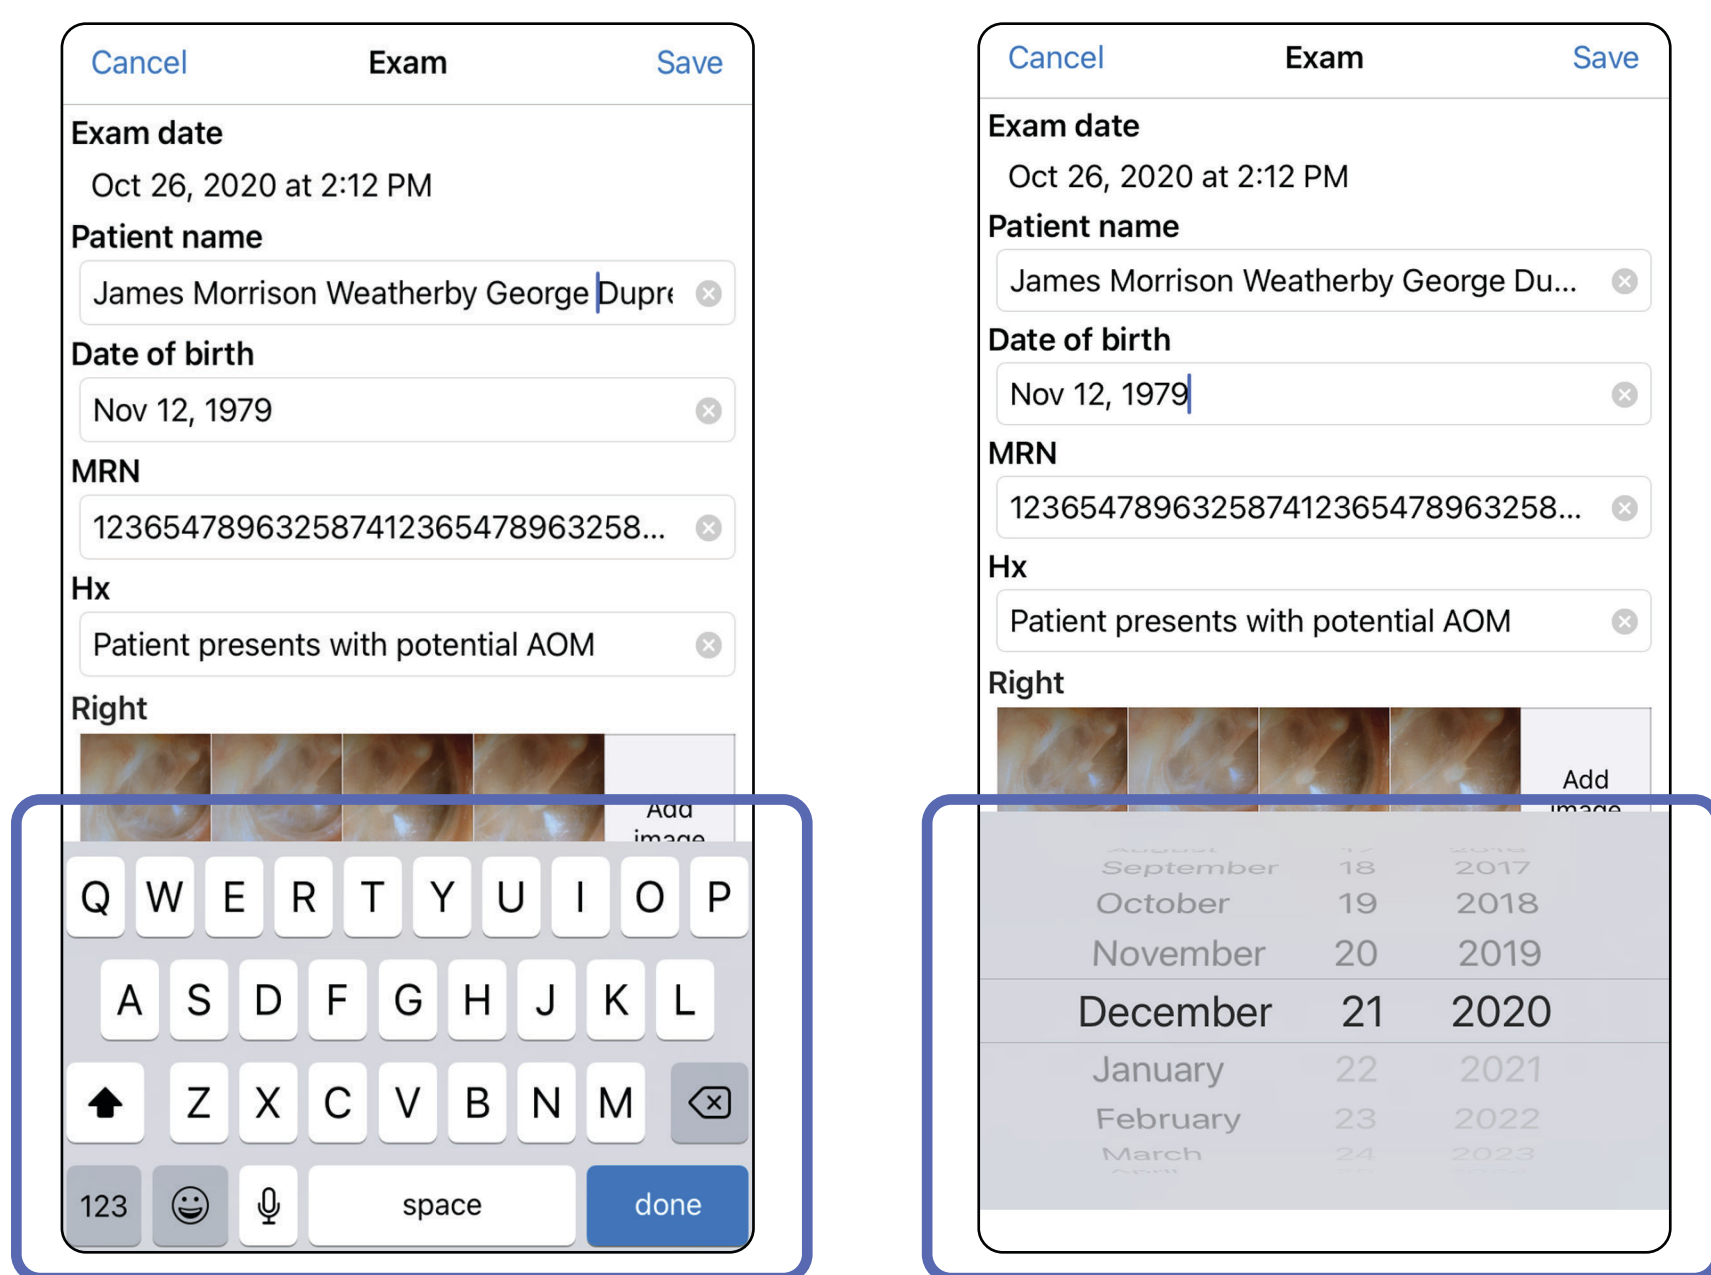

4. Pievienojiet vai noņemiet attēlus. Skatiet sadaļu [Attēlu tveršana \(iOS\)](#) un sadaļu [Attēlu filtrēšana, pārvietošana un dzēšana \(iOS\)](#).
5. Pieskarieties pie **Save** (Saglabāt).




PIEZĪME. Saglabāšana ir pieejama tikai tad, ja notiek izmaiņas un ir aizpildīta nepieciešamā pacienta informācija.

Pāriet uz sarakstu *Lietotnes funkciju izmantošana*


Izmeklējuma koplietošana (iOS)

Attiecas uz: mācību režīms, klīniskais režīms


1. Izmeklējumu ekrānā pieskarieties pie .
2. Lai koplietotu izmeklējumu, sekojiet uzvednēm.



PIEZĪME. Koplietošana ir pieejama, ja izmeklējumā ir vismaz 1 attēls un nepieciešamā pacienta informācija.

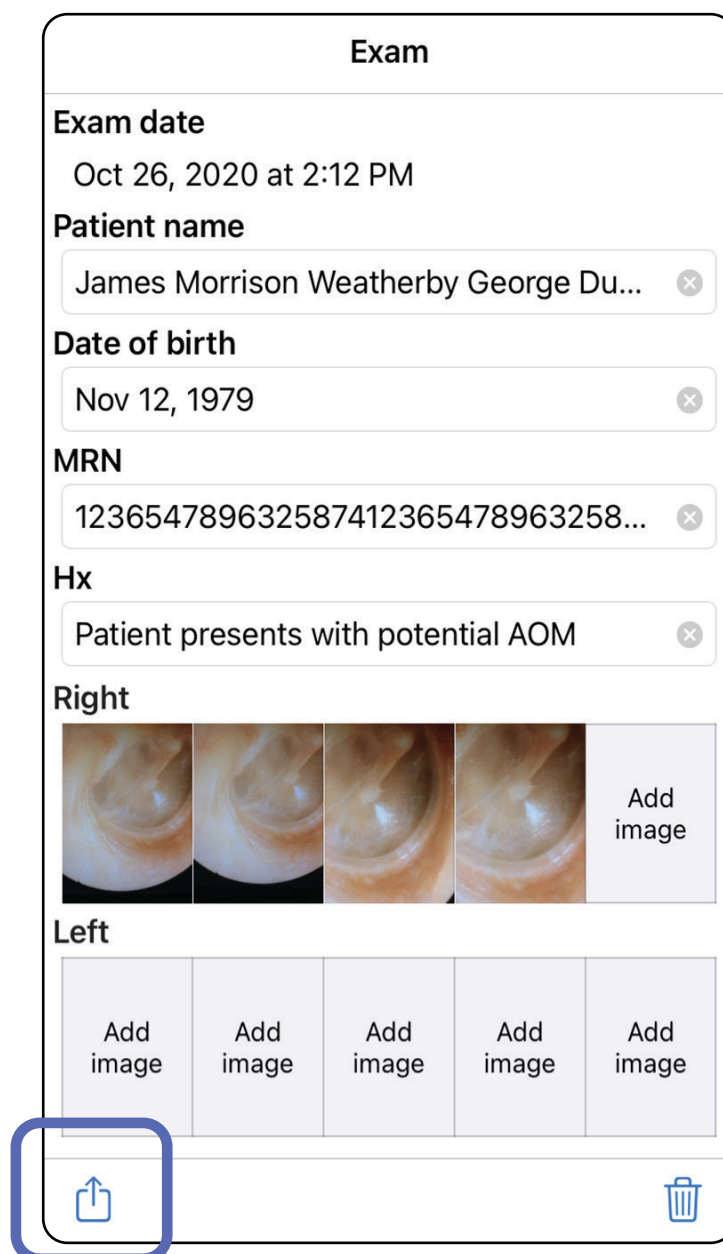

3. Uznirstošajā izvēlnē atlasiet koplietošanas metodi.

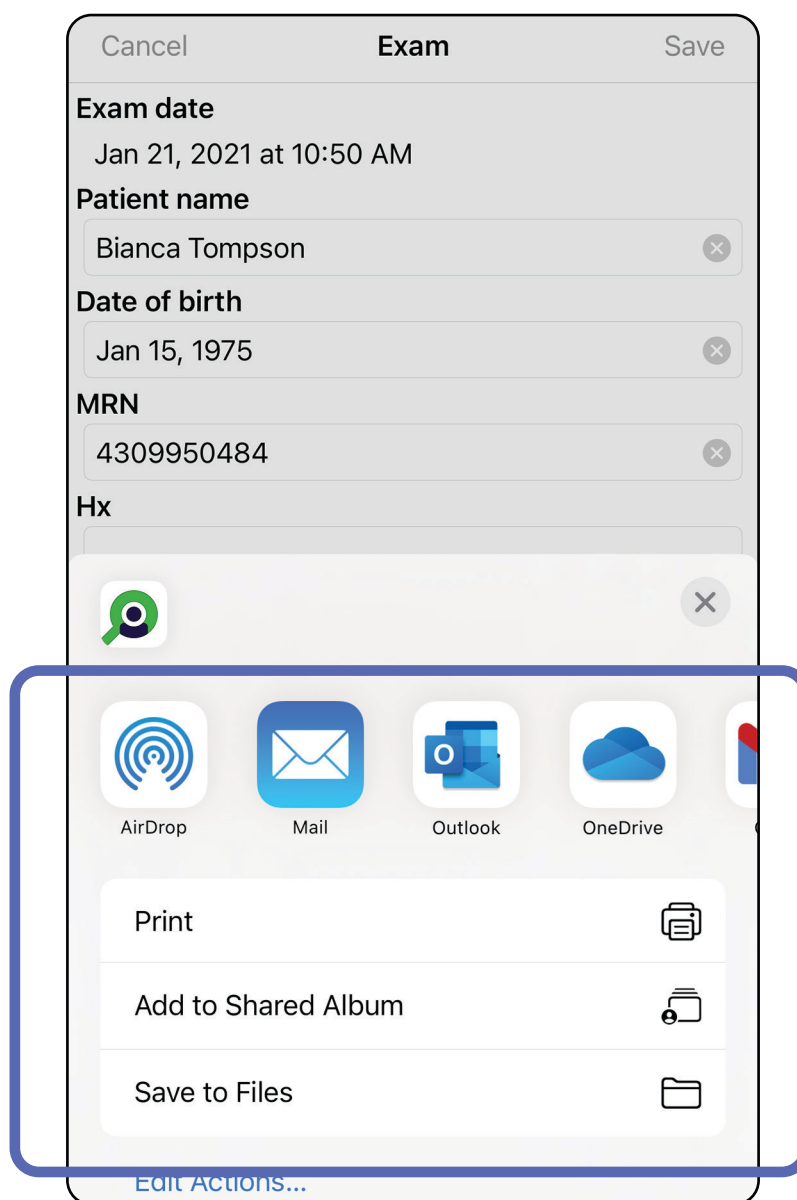

4. Lai koplietotu, sekojiet uzvednēm.



PIEZĪME. Skatiet sadaļu [Ierīces un pacienta dati un drošība](#).




PIEZĪME. Lietotnes iExaminer koplietotajos attēlos var būt iegulta informācija. Dažas fotoattēlu apskates programmas neatbalsta iegulto informāciju. Ja saņēmējs nevar apskatīt fotoattēlu, saņēmējam jāpārlicinās, vai fotoattēlu apskates programma atbalsta attēlu skatīšanu ar iegulto informāciju, vai arī jāizvēlas cita fotoattēlu apskates programma.

Pāriet uz sarakstu *Lietotnes funkciju izmantošana*

Attēla koplietošana (iOS)

Attiecas uz: mācību režīms, klīniskais režīms

1. Izmeklējumu ekrānā pieskarieties nepieciešamajam attēlam.
2. Pieskarieties pie .





PIEZĪME. Koplietošana ir pieejama tikai tad, ja izmeklējumā ir norādīta nepieciešamā pacienta informācija.




Pāriet uz sarakstu *Lietotnes funkciju izmantošana*

3. Uznirstošajā izvēlnē atlasiet koplietošanas metodi un sekojiet uzvednēm, lai koplietotu.

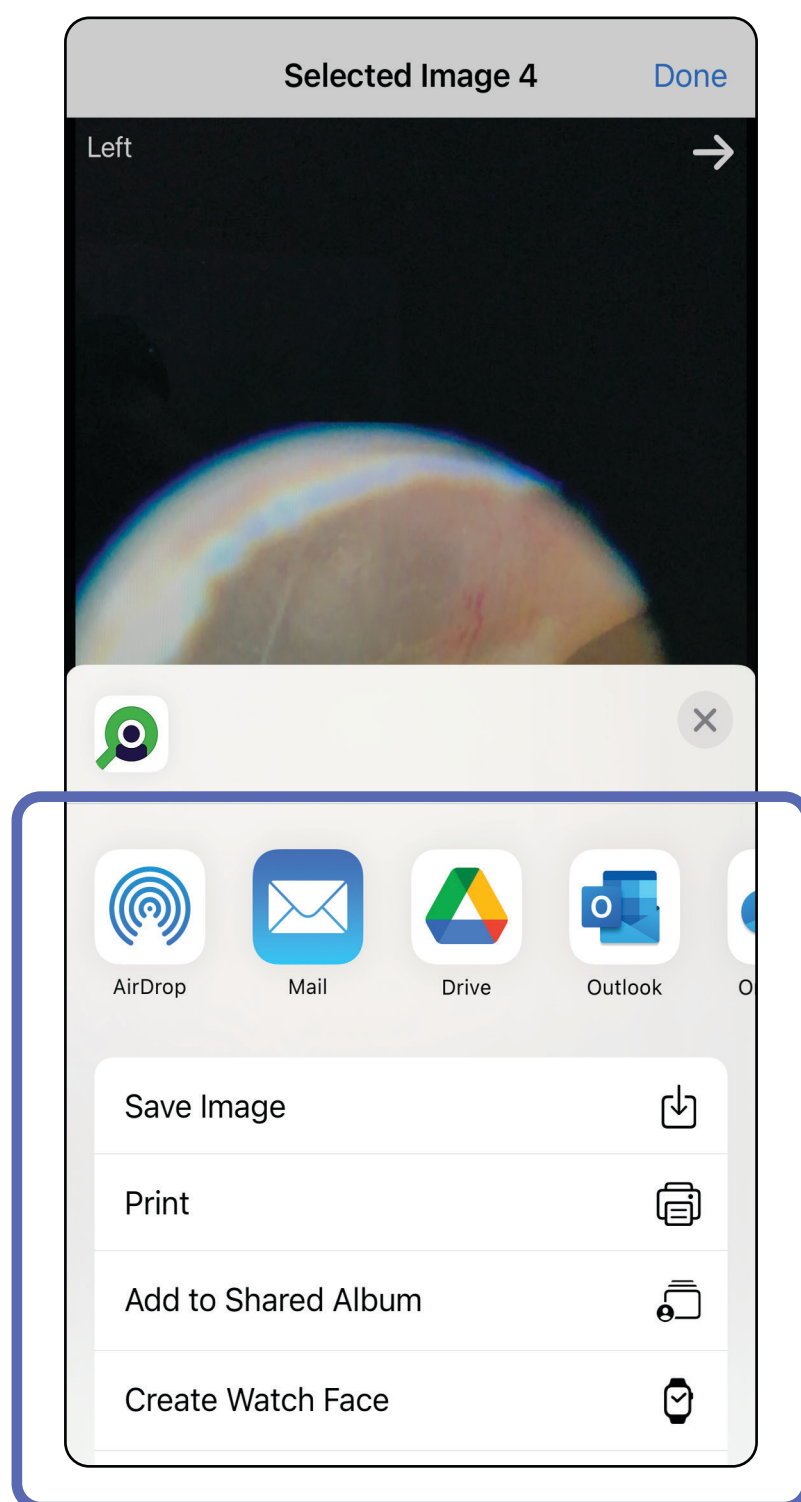

 **PIEZĪME.** Skatiet sadaļu [Ierīces un pacienta dati un drošība](#).

 **PIEZĪME.** Lietotnes iExaminer koplietotajos attēlos var būt iegulta informācija. Dažas fotoattēlu apskates programmas neatbalsta iegulto informāciju. Ja saņēmējs nevar apskatīt fotoattēlu, saņēmējam jāpārlicinās, vai fotoattēlu apskates programma atbalsta attēlu skatīšanu ar iegulto informāciju, vai arī jāizvēlas cita fotoattēlu apskates programma.


Pāriet uz sarakstu *Lietotnes funkciju izmantošana*

Izmeklējuma dzēšana (iOS)


Attiecas uz: mācību režīms

Lai dzēstu izmeklējumu, ir 2 izvēles iespējas.


1. opcija — pavilkt, lai dzēstu.
 1. Lai dzēstu saglabātu izmeklējumu, pavelciet pa kreisi uz saglabātā izmeklējuma nosaukuma.
 2. Pieskarieties pie **Delete** (Dzēst), lai apstiprinātu.

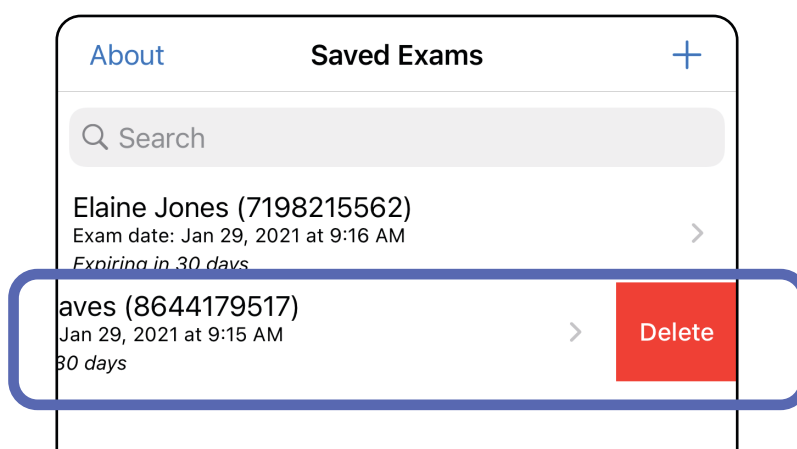


3. Uznirstošajā logā, pieskarieties pie **OK** (Labi), lai apstiprinātu.

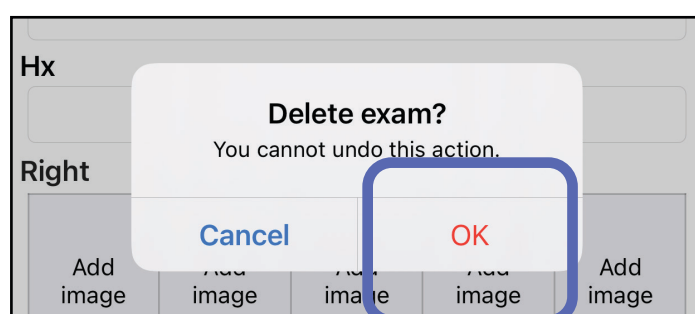

2. opcija — Skatiet izmeklējumu, kuram ir beidzies derīguma termiņš, tad pieskarieties pie .

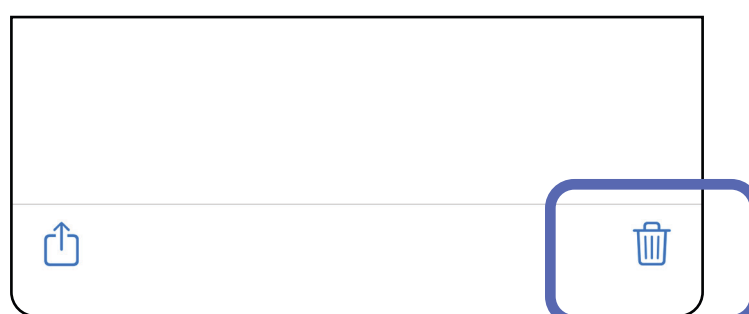


 **PIEZĪME.** Izdzēstu izmeklējumu nevar atgūt.

Pāriet uz sarakstu *Lietotnes funkciju izmantošana*


Izmeklējuma atmešana (iOS)

Attiecas uz: klīniskais režīms

1. Lai atmestu izmeklējumu, pieskarieties pie **New** (Jauns).

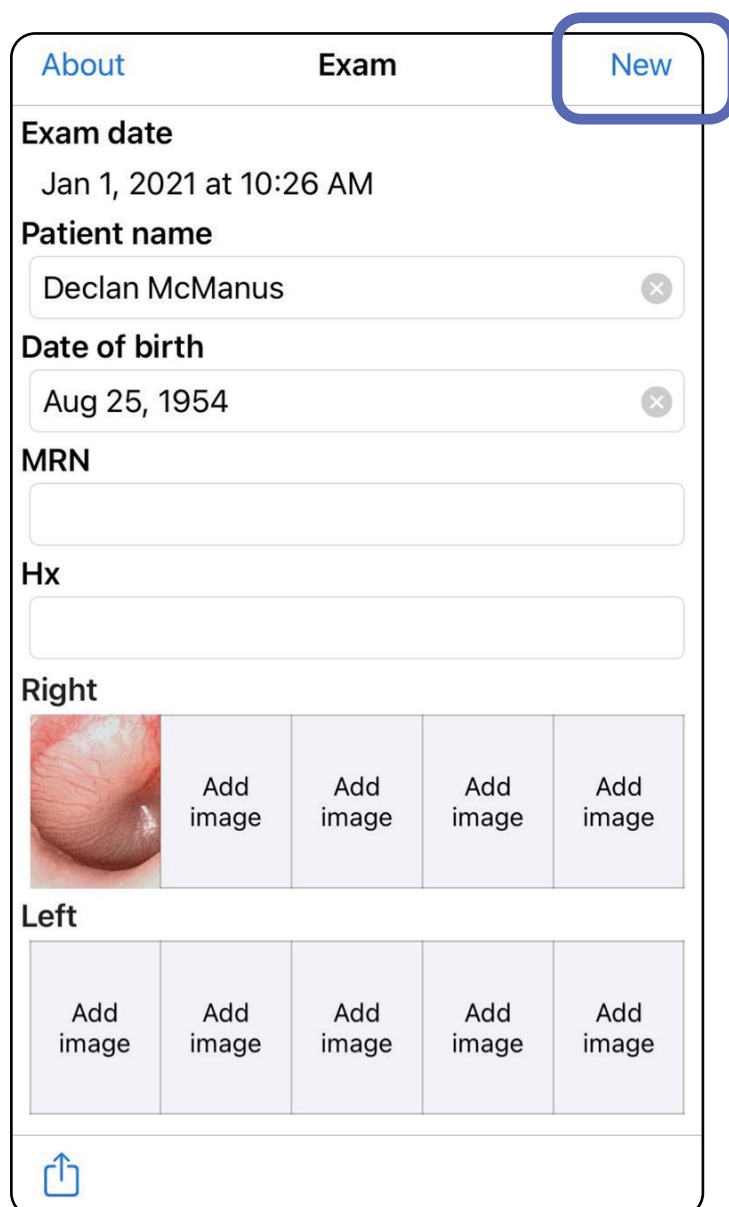

2. Pieskarieties pie **OK** (Labi), lai atmestu izmaiņas un sāktu jaunu izmeklējumu.

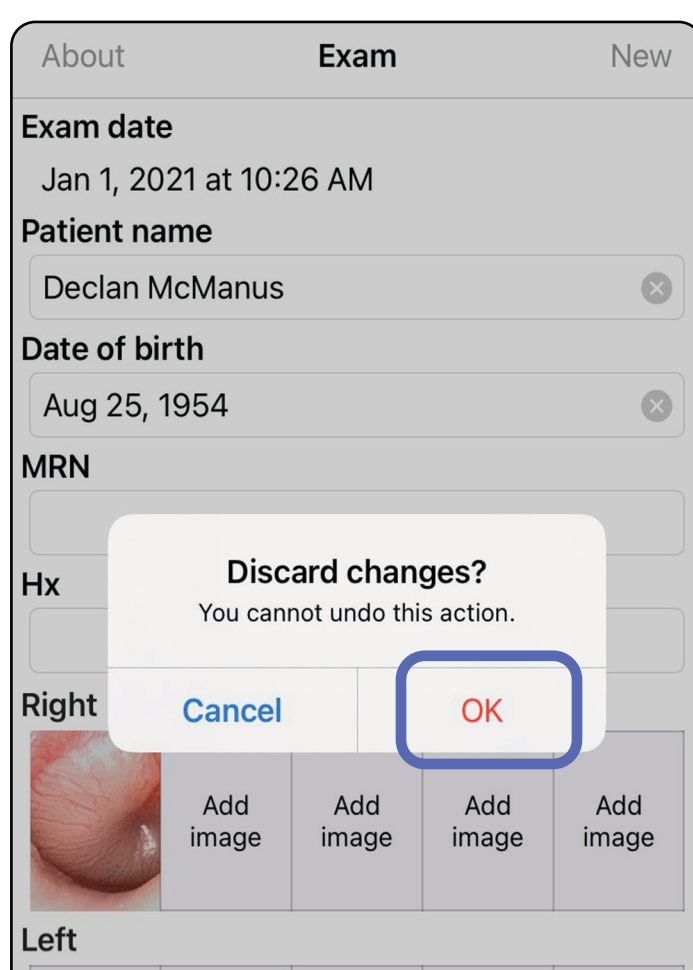

Pāriet uz sarakstu *Lietotnes funkciju izmantošana*

Android norādes



PIEZĪME. Attēli tiek rādīti ilustratīvos nolūkos.




PIEZĪME. Izmeklējuma ekrānā tiek atvērts klīniskais režīms.


Ekrāna elementi (Android)

Attiecas uz: mācību režīms, klīniskais režīms

Ikona Definīcija



Koplietot



Dzēst



Filtrēt



Pievienot



Atpakaļ



Pabeigts



Pārvietot


Pāriet uz sarakstu *Lietotnes funkciju izmantošana*

Iestatījumu modificēšana (Android)


Attiecas uz: mācību režīms, klīniskais režīms

Modificējiet iestatījumus, piemēram, attēla izšķirtspēju vai datu saglabāšanas periodu. Daži iestatījumi var būt pieejami tikai noteiktā režīmā.

1. Lietotnē pieskarieties izvēlnes ikonai augšējā labajā stūrī.

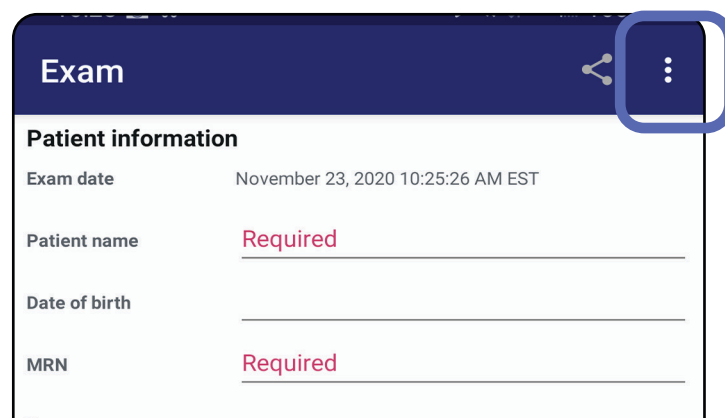

2. Pieskarieties pie **Settings** (iestatījumi).
3. Modificējiet iestatījumu opcijas. [Montāžas pārbaude](#) vēlreiz, ja maināt attēla izšķirtspēju.
4. Lai saglabātu iestatījumus, pieskarieties pie ← augšējā kreisajā stūrī.

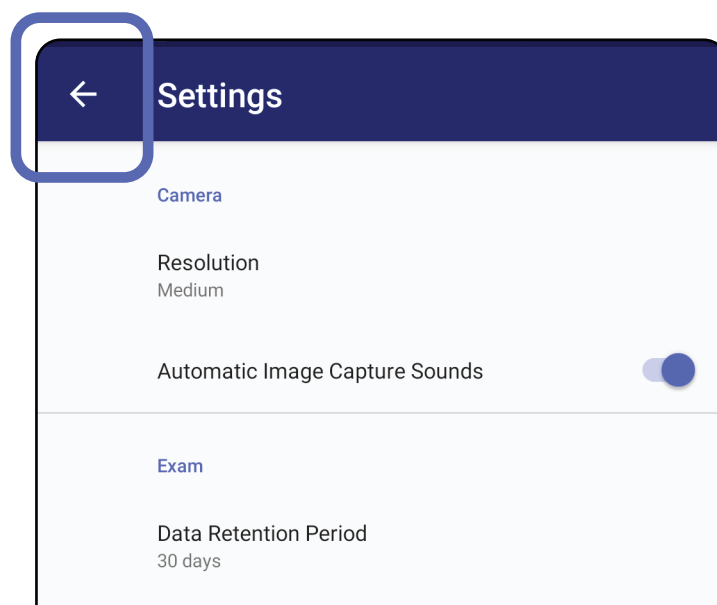

Pāriet uz sarakstu *Lietotnes funkciju izmantošana*

Autentifikācija (Android)

Attiecas uz: mācību režīms

Autentifikācijas ekrānā pieejamās darbības

- [Paroles iestatīšana \(Android\)](#)
- [Paroles atiestatīšana \(Android\)](#)
- [Pieteikšanās \(Android\)](#)

Paroles iestatīšana (Android)

Attiecas uz: mācību režīms

1. Iestatiet paroli, kas atbilst validācijas kritērijiem.
2. Autentifikācijas ekrānā divreiz ievadiet jauno paroli.
3. Pieskarieties pie **Set** (Iestatīt).

Authentication

Enter a new password.

Password

Confirm password

SET

Pāriet uz sarakstu *Lietotnes funkciju izmantošana*

Paroles atiestatīšana (Android)

Attiecas uz: mācību režīms

1. Lai atiestatītu paroli, autentifikācijas ekrānā pieskarieties pie **Reset** (Atiestatīt).
2. Divreiz ievadiet jauno paroli.
3. Pieskarieties pie **Reset** (Atiestatīt), lai apstiprinātu paroles atiestatīšanu. Šo darbību nevar atsaukt.



PIEZĪME. Atiestatot paroli, no lietotnes tiek dzēsti visi esošie izmeklējumi.

Authentication

Please enter a new password.

WARNING: This will delete all existing exams!

Password:

Confirm password:

CANCEL RESET

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

+ × ÷ = / _ < > []

q w e r t y u i o p

! @ # \$ % & * ()

↑ z x c v b n m ↵

!@# ? , English (US) . Next

Pāriet uz sarakstu *Lietotnes funkciju izmantošana*

Pieteikšanās (Android)

Attiecas uz: mācību režīms

1. Atveriet lietotni.
2. Autentifikācijas ekrānā ievadiet savu paroli.
3. Pieskarieties pie **Login** (Pieteikties).

Authentication

Enter your password.

Password


RESET LOG IN

Izmeklējumi, kuriem beidzies derīguma termiņš (Android)


Attiecas uz: mācību režīms

Kad lietotne ir atvērta mācību režīmā un ir izmeklējumi, kuriem beidzies derīguma termiņš, tie ir jāizdzēš, lai turpinātu izmantot lietotni. Ja kādam izmeklējumam ir beidzies derīguma termiņš, tiks parādīts brīdinājums.

1. Pieskarieties pie OK (Labi), lai apstiprinātu brīdinājumu.

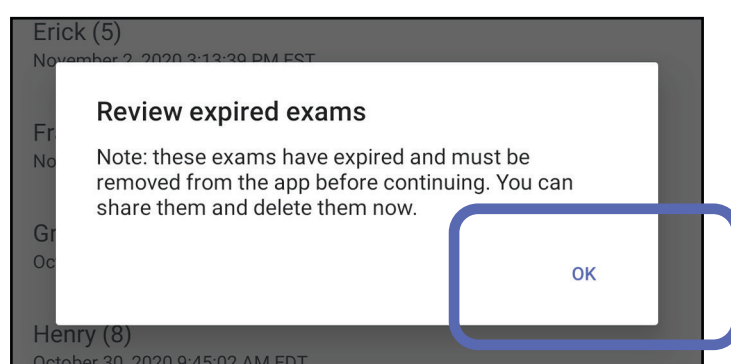

2. Pārskatiet sarakstu ar izmeklējumiem, kuriem beidzies derīguma termiņš.

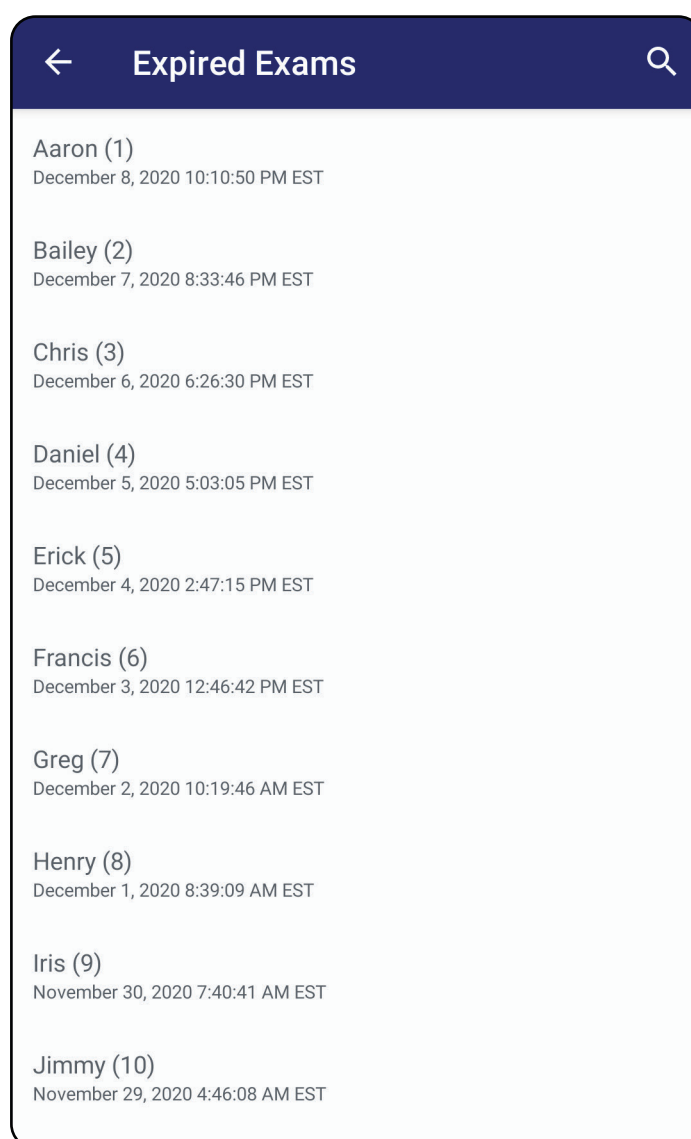


3. [Skatīt izmeklējumu, kuram beidzies derīguma termiņš \(Android\)](#) kur var koplietot vai dzēst izmeklējumu un koplietot izmeklējuma attēlus vai [Dzēst izmeklējumus, kuriem beidzies derīguma termiņš \(Android\)](#).


Pāriet uz sarakstu *Lietotnes funkciju izmantošana*

Skatīt izmeklējumu, kuram beidzies derīguma termiņš (Android)

Attiecas uz: mācību režīms

Pieskarieties sarakstā esošam izmeklējumam, kuram beidzies derīguma termiņš, lai to apskatītu. Izmeklējums, kuram beidzies derīguma termiņš, ir tikai lasāms un tas ir jāizdzēš pirms cita izmeklējuma sākšanas. Pirms dzēst izmeklējumu, kuram beidzies derīguma termiņš, varat:

- Pieskarieties attēlam, lai [Skatīt attēlu izmeklējumam, kuram beidzies derīguma termiņš \(Android\)](#).
- Pieskarieties pie , lai [Izmeklējuma koplietošana \(Android\)](#).

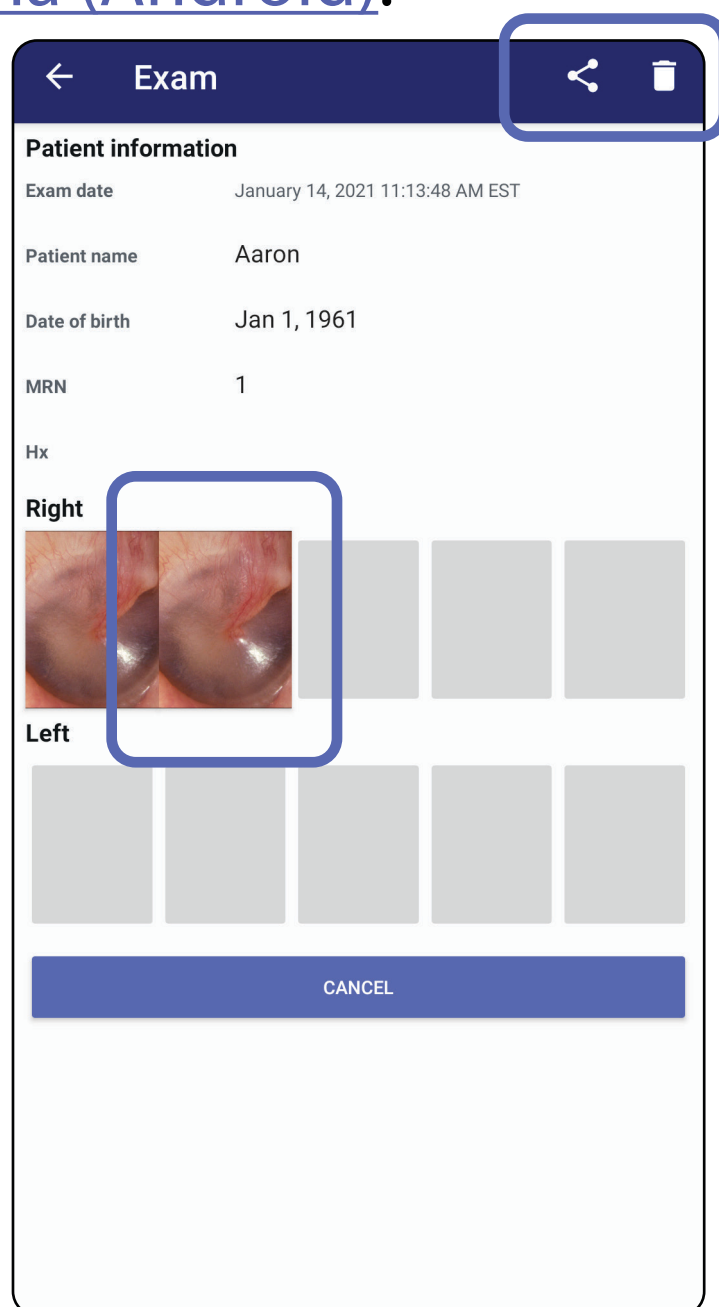




- Skatiet sadaļu [Dzēst izmeklējumus, kuriem beidzies derīguma termiņš \(Android\)](#).

Skatīt attēlu izmeklējumam, kuram beidzies derīguma termiņš (Android)

Attiecas uz: mācību režīms

Izmeklējuma, kuram beidzies derīguma termiņš, ekrānā pieskarieties attēlam, lai to atvērtu.

- Pieskarieties pie , lai [Lietot filtru attēlam \(Android\)](#) izmeklējumā, kuram beidzies derīguma termiņš.
- Pieskarieties pie , lai [Attēla koplietošana \(Android\)](#) izmeklējumā, kuram beidzies derīguma termiņš.

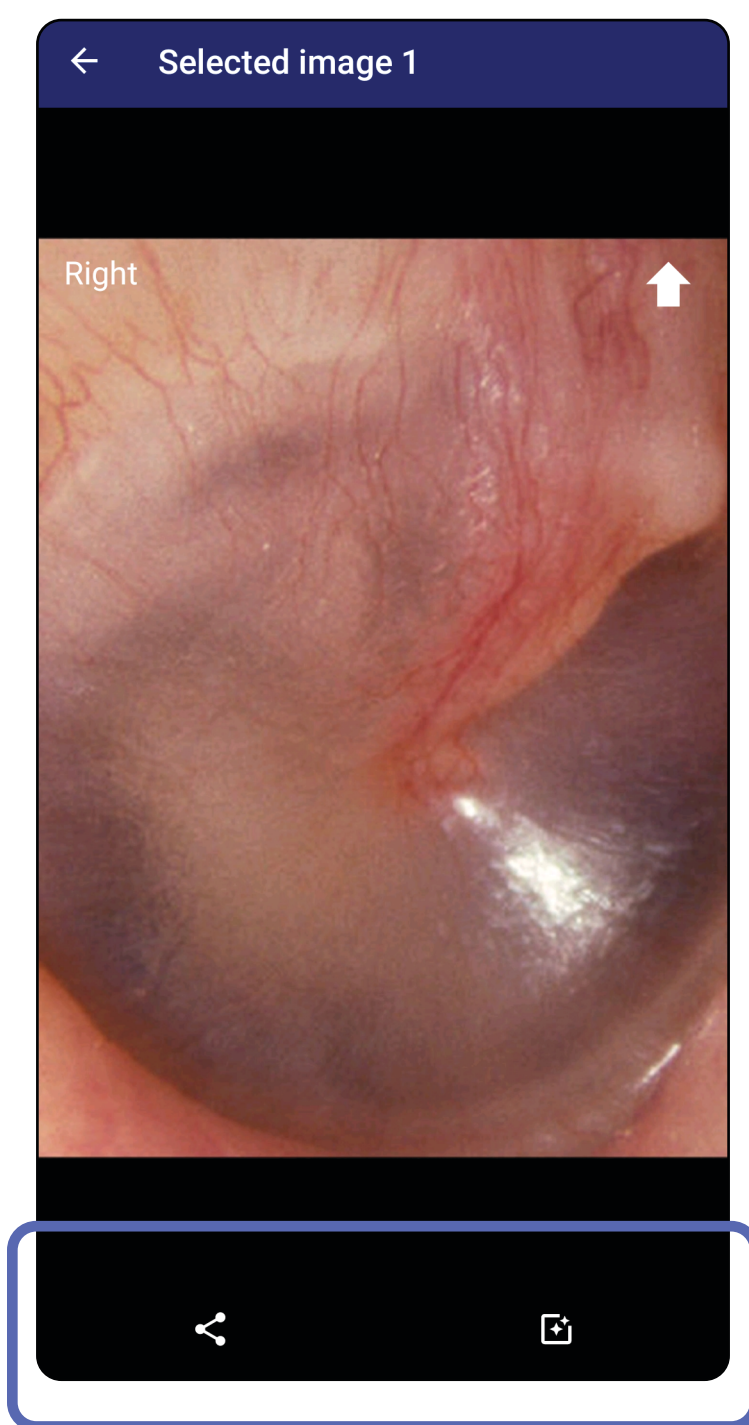


Pāriet uz sarakstu *Lietotnes funkciju izmantošana*

Dzēst izmeklējumus, kuriem beidzies derīguma termiņš (Android)


Attiecas uz: mācību režīms

Lai dzēstu visus izmeklējumus, kuriem beidzies derīguma termiņš:

1. Pieskarieties pie ← .

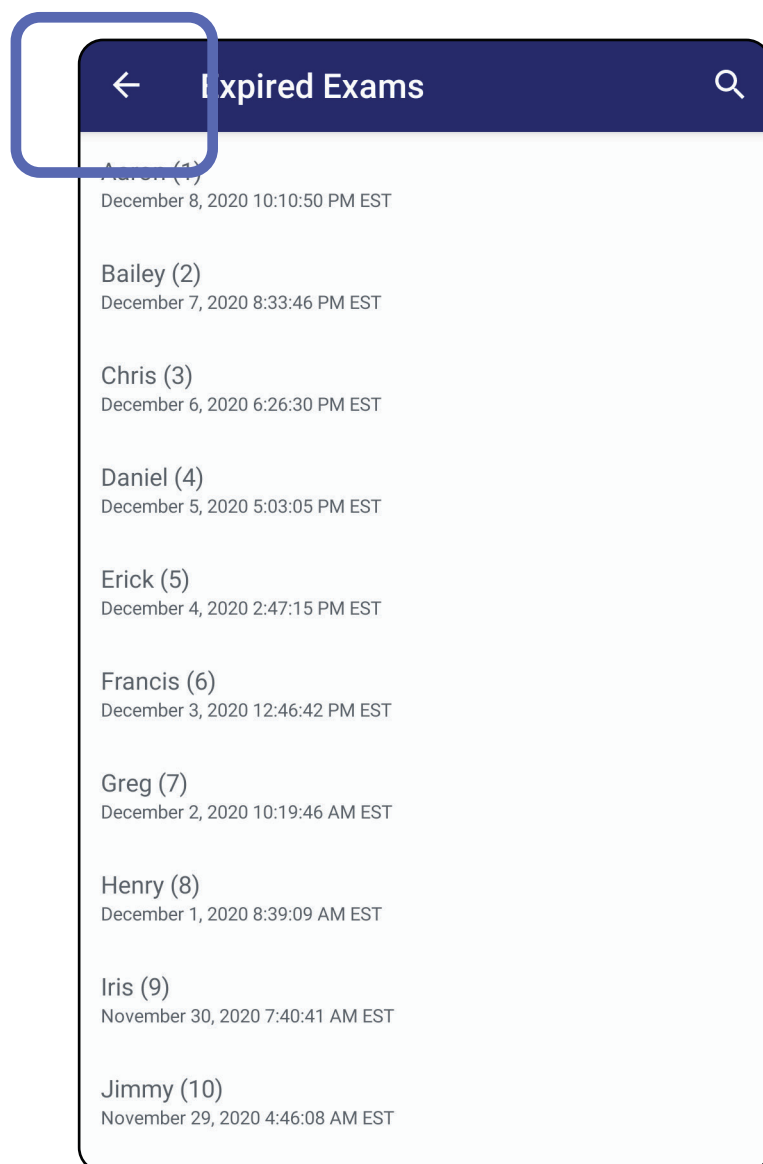


2. Pieskarieties pie **OK** (Labi), lai apstiprinātu uznirstošajā logā.

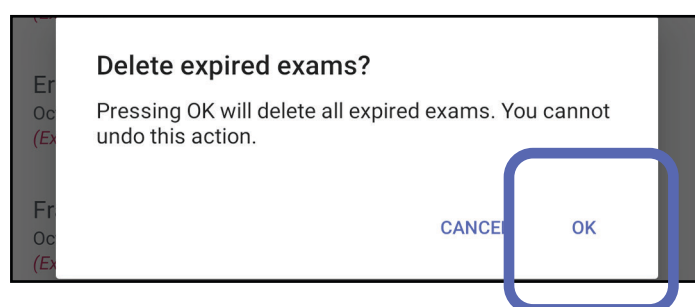

Lai dzēstu izmeklējumu, kuram ir beidzies derīguma termiņš, ir 2 izvēles iespējas.


1. opcija — pavilkt, lai dzēstu.

Pavilkt pa kreisi vai pa labi uz izmeklējuma nosaukuma, kuram ir beidzies derīguma termiņš.

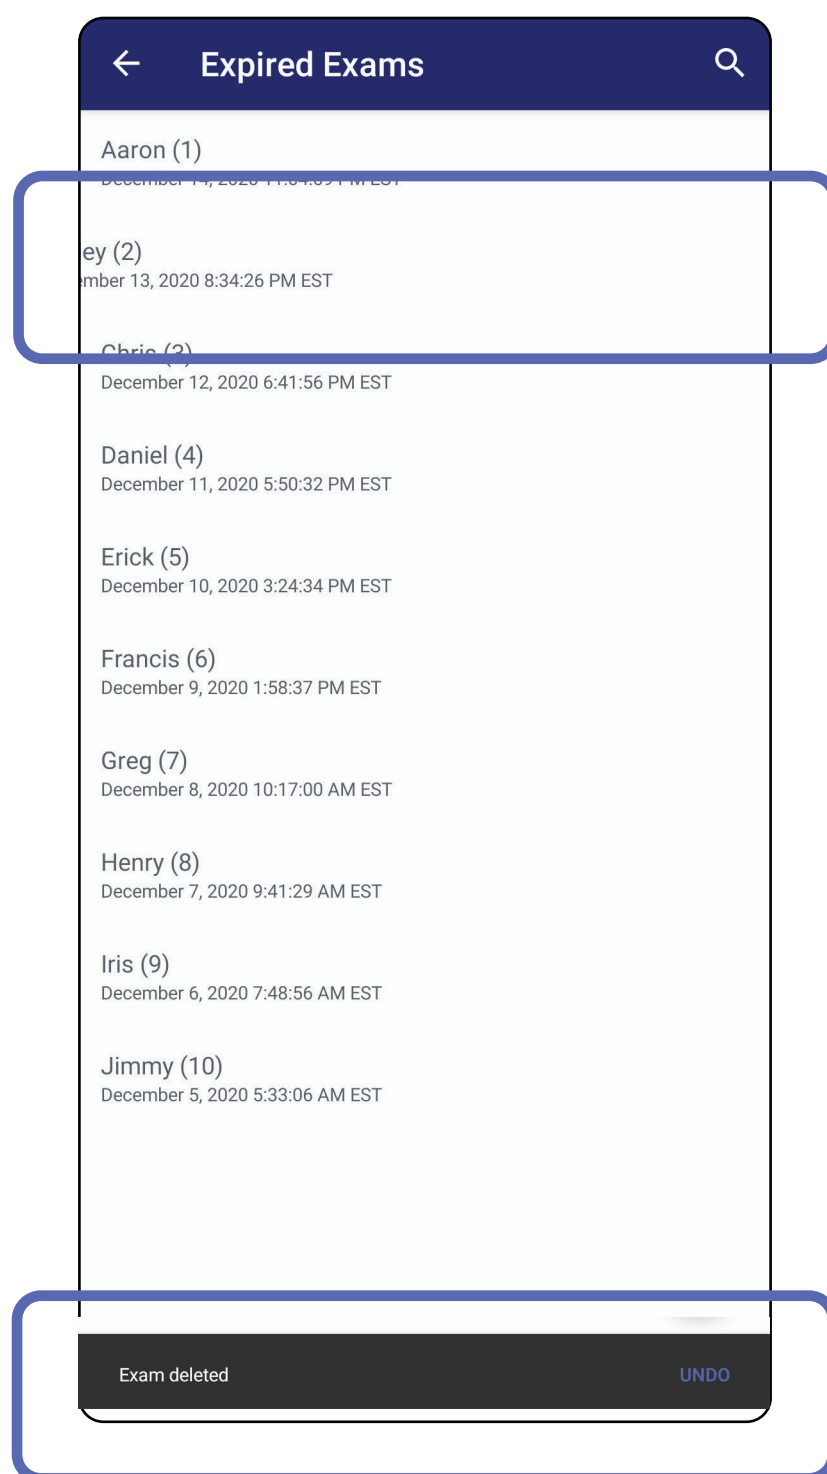

Uznirstošajā logā 15 sekunžu laikā pieskarieties pie **UNDO** (Atsaukt), lai atsauktu dzēšanu.

2. opcija — Skatiet izmeklējumu, kuram ir beidzies derīguma termiņš, tad pieskarieties pie  .

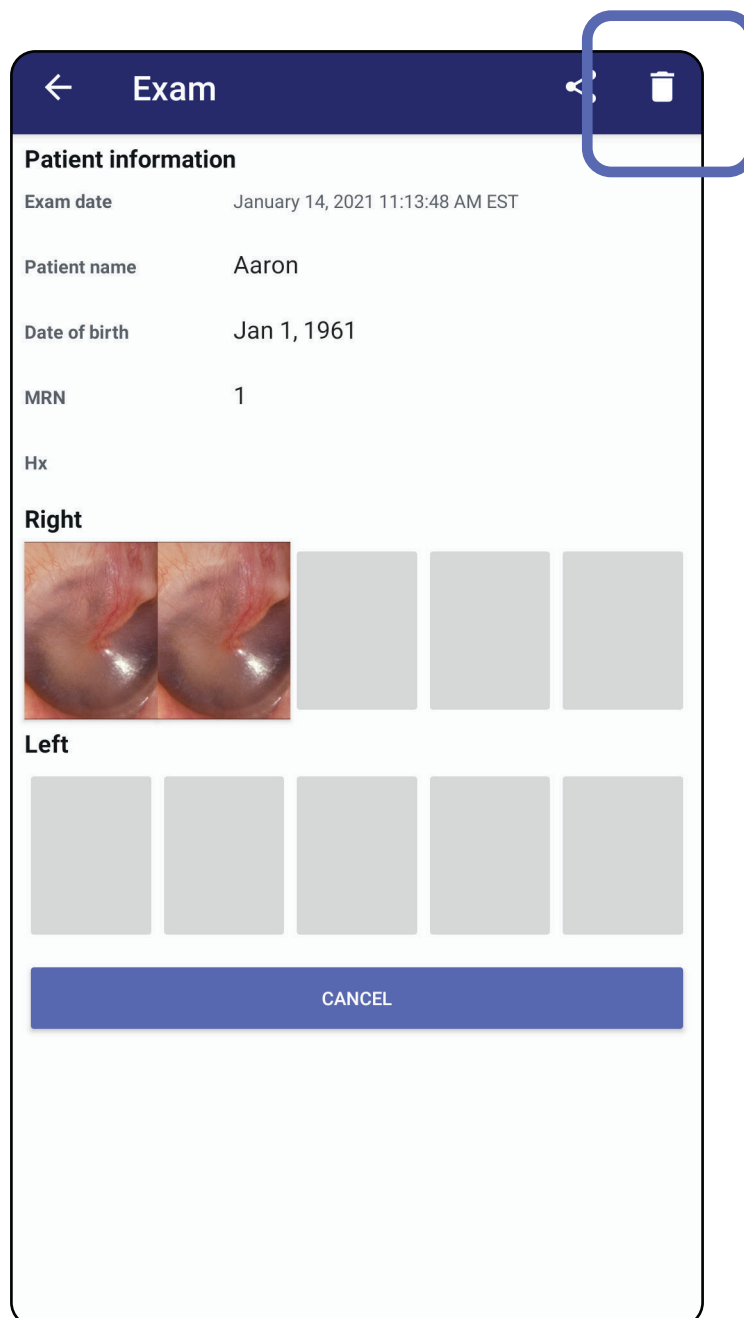


Pāriet uz sarakstu *Lietotnes funkciju izmantošana*

Izmeklējumi, kuriem drīz beigsies derīguma termiņš (Android)

Attiecas uz: mācību režīms

Ja ir izmeklējumi, kuriem drīz beigsies derīguma termiņš, parādās dialoglodziņš "Izmeklējumi, kuriem drīz beigsies derīguma termiņš".


Pieskarieties pie **OK** (Labi), pārskatītu izmeklējumus, kuriem drīz beigsies derīguma termiņš.

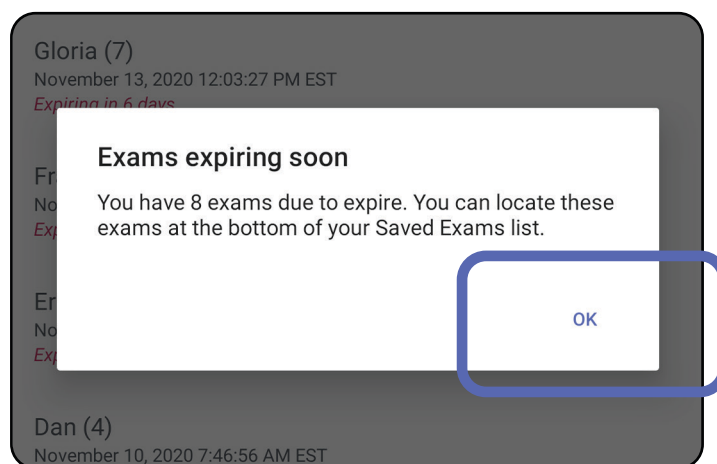

Skatīt izmeklējumus, kuriem drīz beigsies derīguma termiņš (Android)

Attiecas uz: mācību režīms

Kamēr nav beidzies izmeklējuma derīguma termiņš, nekādas darbības nav jāveic.

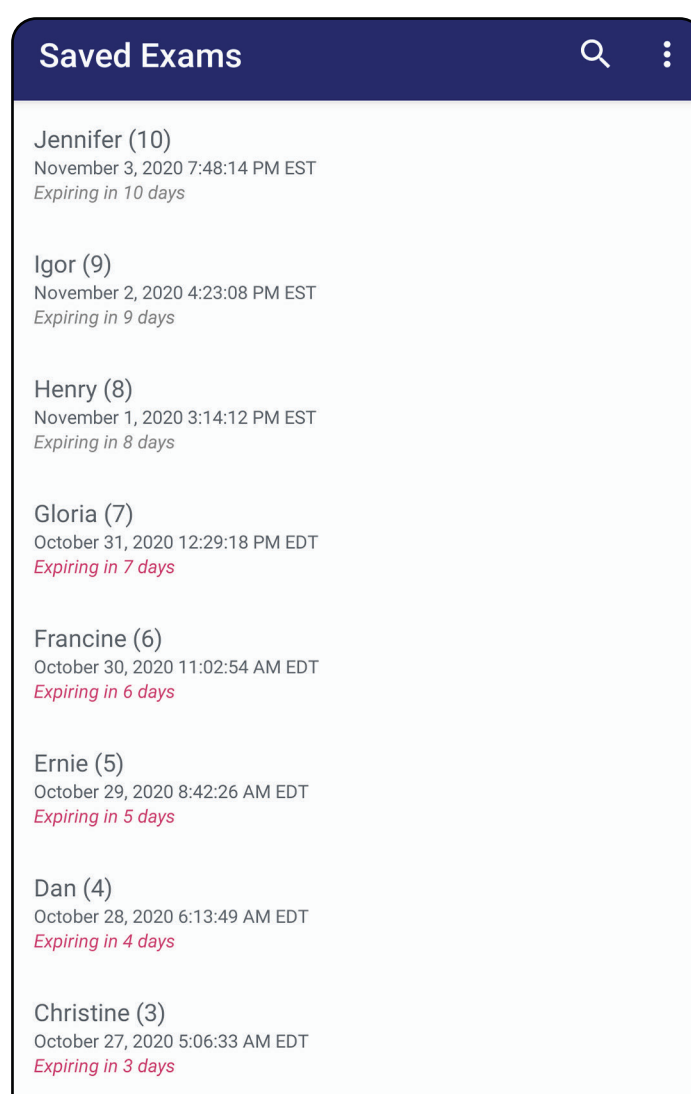


Pāriet uz sarakstu *Lietotnes funkciju izmantošana*

Izmeklējuma pievienošana (Android)

Attiecas uz: mācību režīms

1. Pieskarieties pie +, lai pievienotu jaunu izmeklējumu.
2. Skatiet sadaļu [Attēlu tveršana \(Android\)](#).

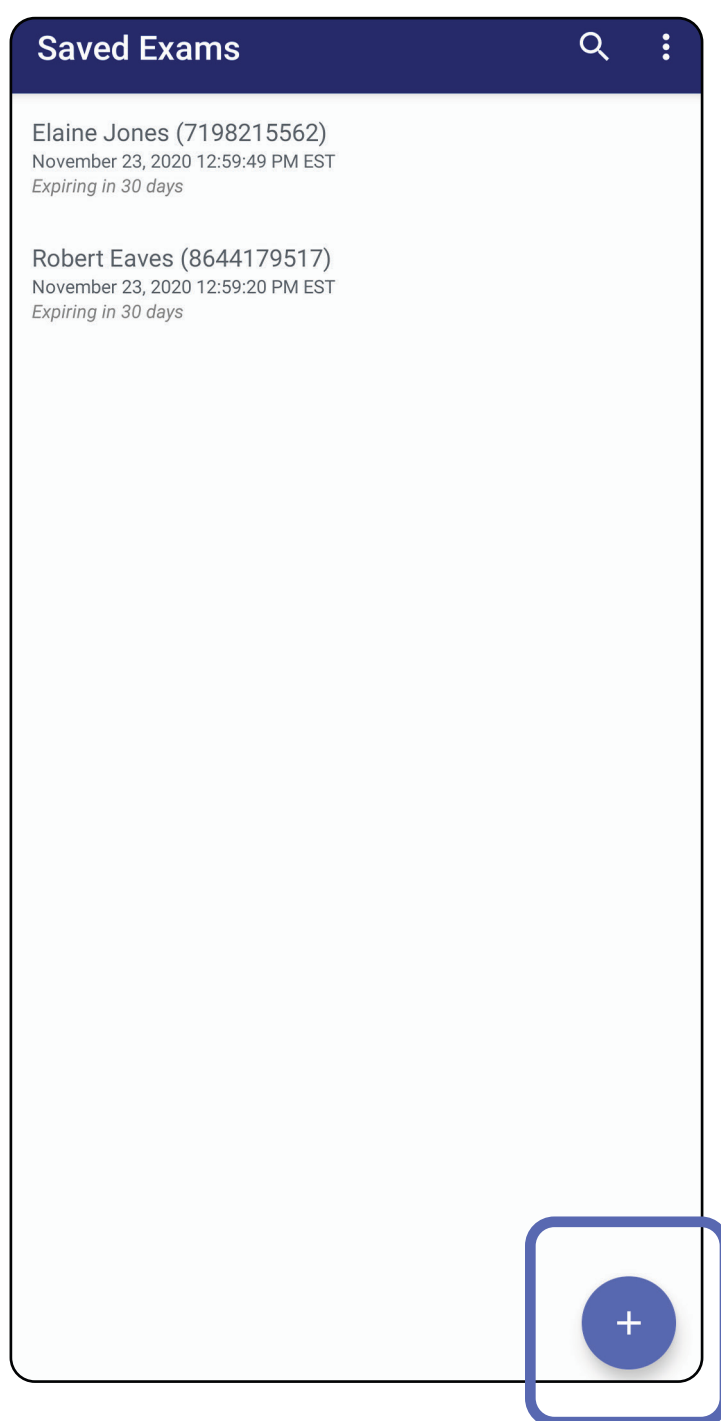


Pāriet uz sarakstu *Lietotnes funkciju izmantošana*


Attēlu tveršana (Android)

Attiecas uz: mācību režīms, klīniskais režīms


1. Novietojiet ierīci izvēlētajā pusē. Lai veiktu izmeklējumu, skatiet video un citus mācību materiālus vietnē hillrom.com
2. Pieskarieties pie **Add image** (Pievienot attēlu), lai tvertu attēlus labajai un kreisajai pusei.

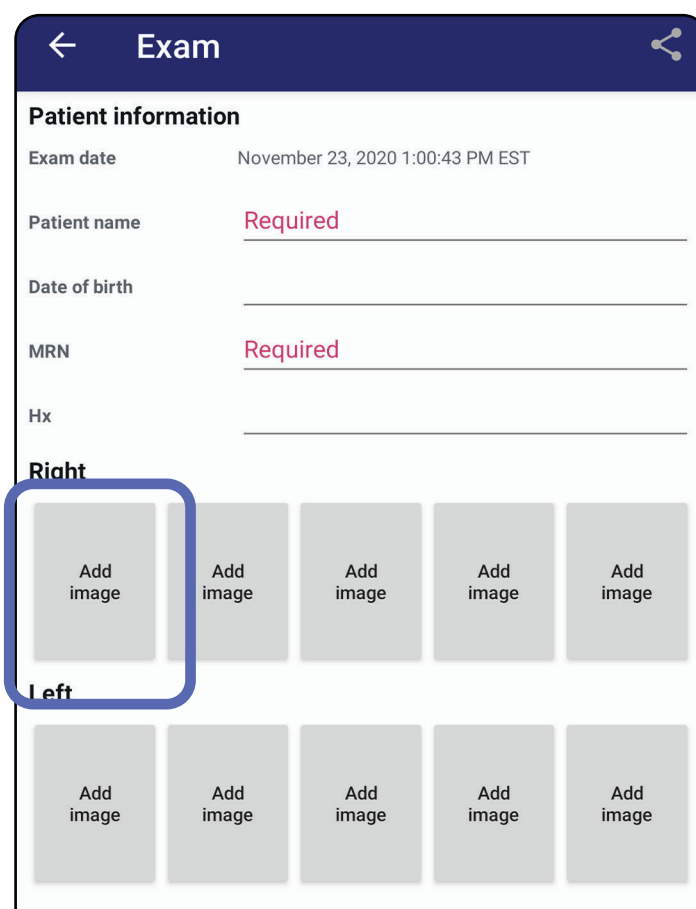

3. Ja tajā pašā pusē ir iepriekšējs ieraksts, uznirstošajā izvēlnē atlasiet opciju, lai sāktu **New recording** (Jauns ieraksts) vai saglabātu attēlus no **Previous recording** (Iepriekšējais ieraksts). Skatiet sadaļu [Attēlu atlasīšana \(Android\)](#).

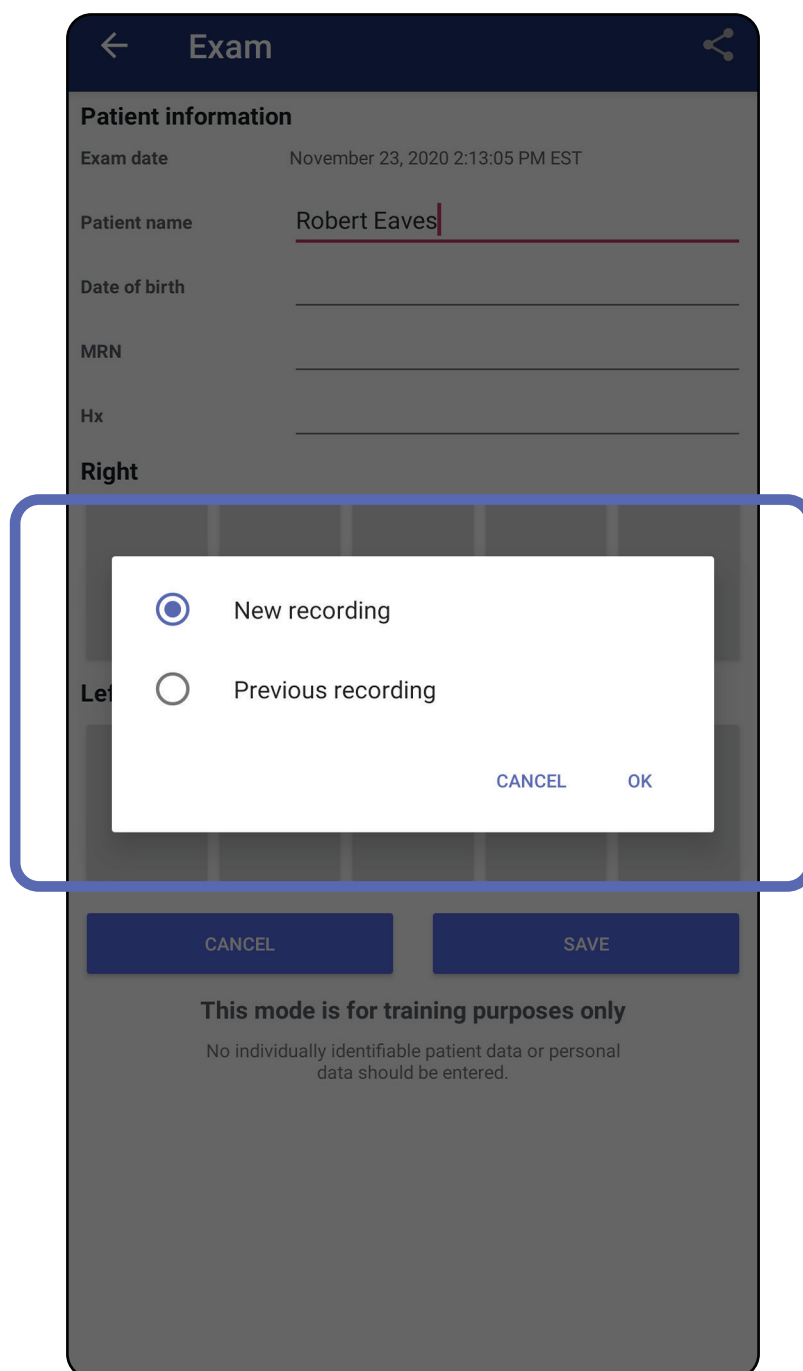

Ja iepriekšēja ieraksta tajā pašā pusē nav, ierakstīšana tiek sākta un apturēta automātiski. Skatiet sadaļu [Attēlu atlasīšana \(Android\)](#).

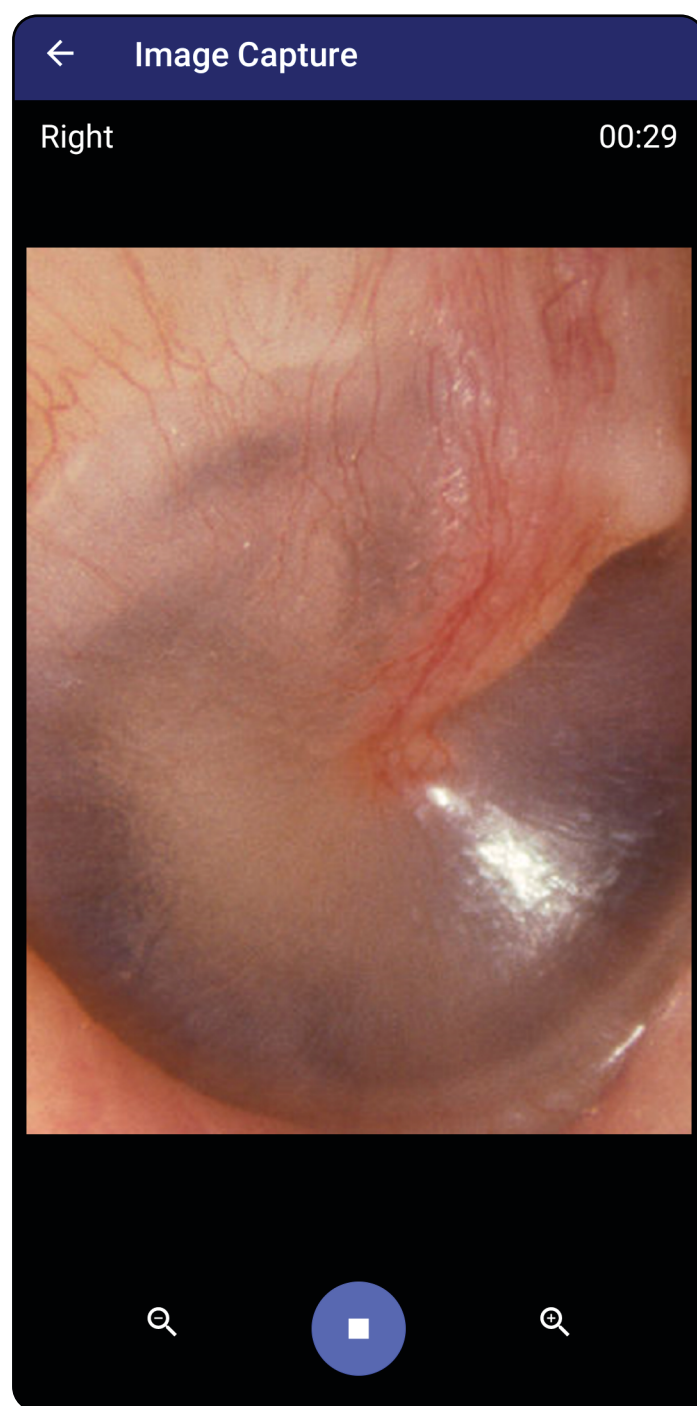

Pāriet uz sarakstu *Lietotnes funkciju izmantošana*

Attēlu atlasīšana (Android)

Attiecas uz: mācību režīms, klīniskais režīms


1. Atlasiet attēlus, ko vēlaties saglabāt, izmantojot video atskaņotāja vadīklas lejasdaļā. Izmantojiet slīdņi, lai atrastu attēlu, ko vēlaties saglabāt. Izmantojiet atpakaļgaitas, atskaņošanas/pauzes un pārtīšanas uz priekšu vadīklas, lai pārvietotu atlasi pa vienam kadram vienlaikus.
2. Pieskarieties pie **+** katram attēlam, ko vēlaties saglabāt.
3. Pieskarieties pie **✓** augšējā labajā stūrī.



PIEZĪME. Izmeklējumā var saglabāt ne vairāk kā 5 katras puses attēlus.



PIEZĪME. Bultiņa attēla augšējā labajā stūrī norāda, kurš virziens ir tvertā attēla augšpuse.

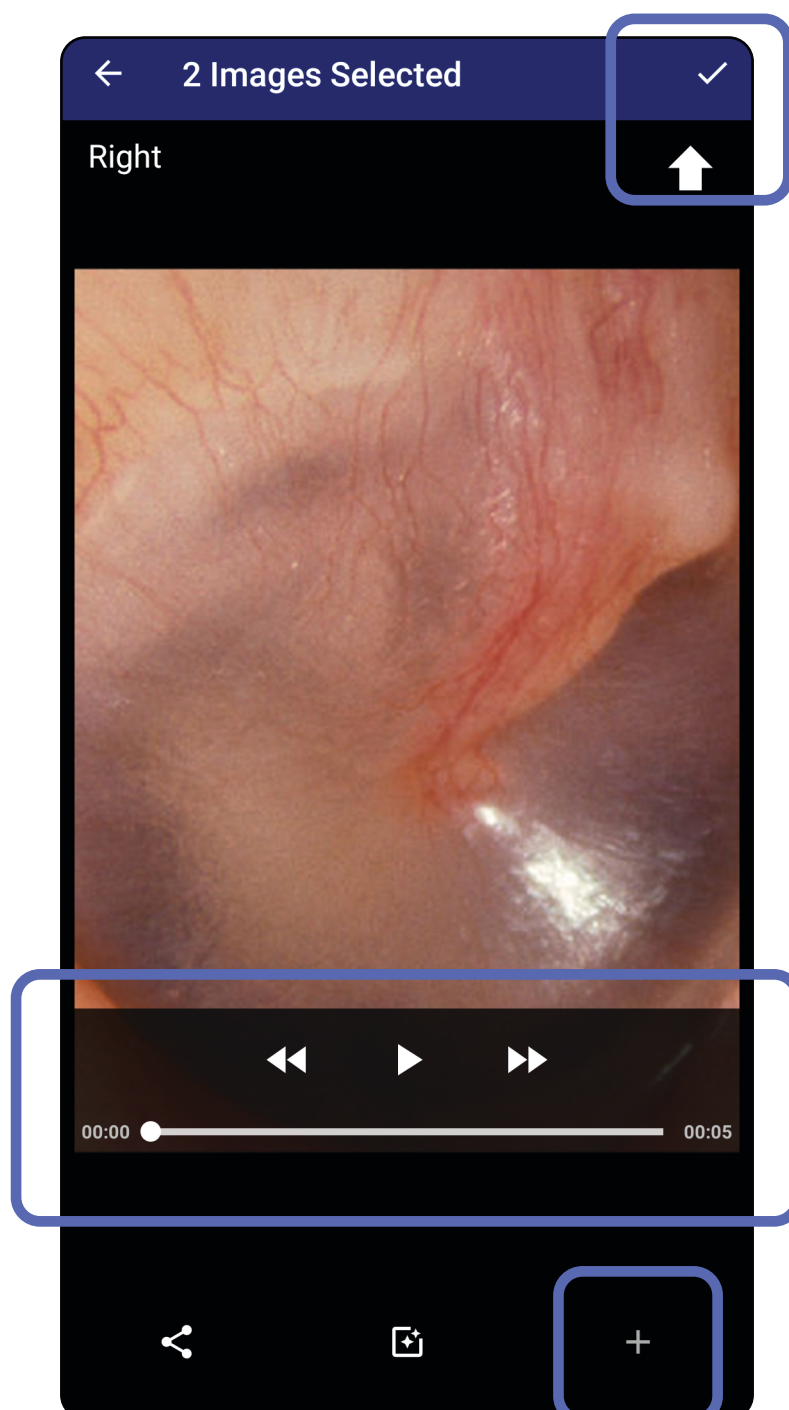

Pāriet uz sarakstu *Lietotnes funkciju izmantošana*


Atlasītā attēla skatīšana (Android)

Attiecas uz: mācību režīms, klīniskais režīms

1. Izmeklējumu ekrānā pieskarieties attēlam.
2. Atlasītā attēla ekrānā pārvelciet pa kreisi vai pa labi, lai ritinātu caur visiem abu pušu attēliem.



PIEZĪME. Bultiņa attēla augšējā labajā stūrī norāda, kurš virziens ir tvertā attēla augšpuse.

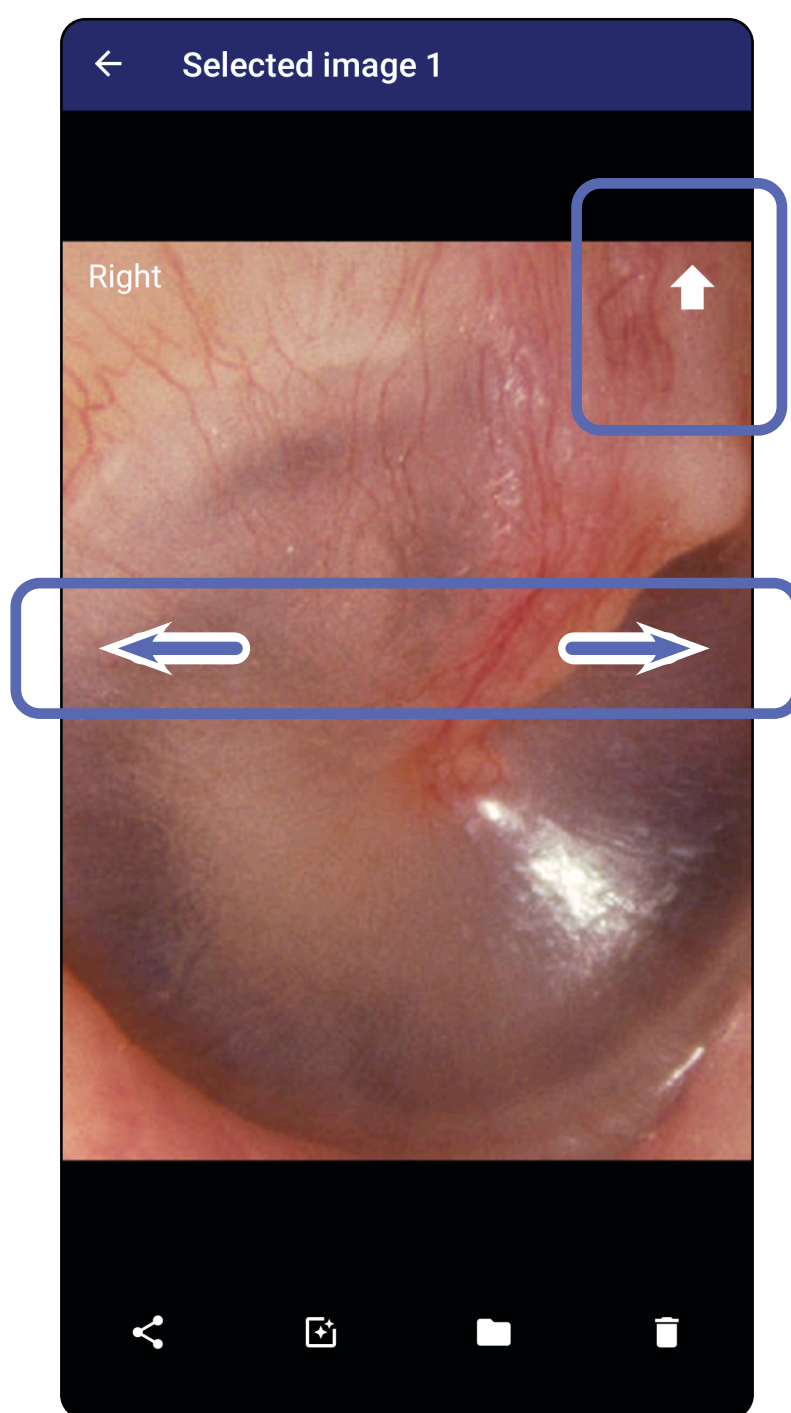




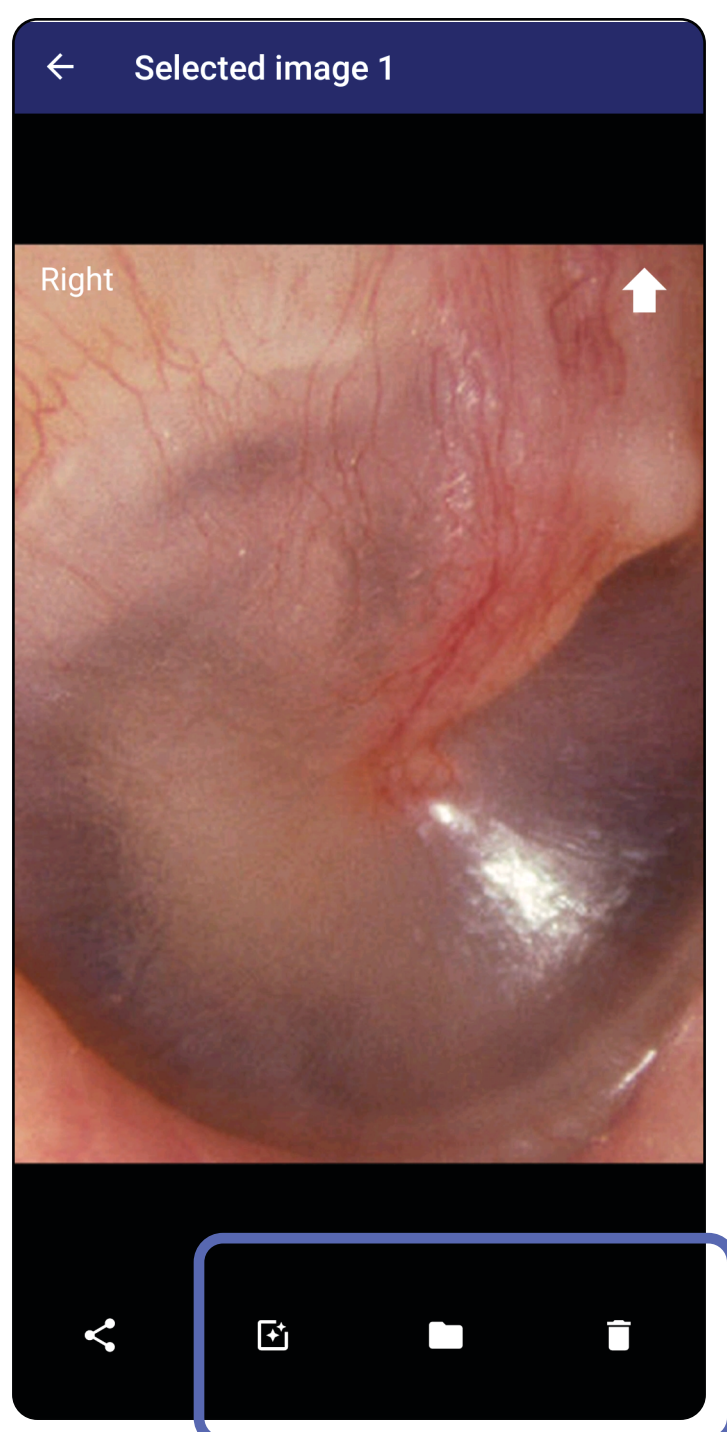
Pāriet uz sarakstu *Lietotnes funkciju izmantošana*

Attēlu filtrēšana, pārvietošana un dzēšana (Android)

Attiecas uz: mācību režīms, klīniskais režīms

Izmeklējumu ekrānā pieskarieties attēlam, lai to atvērtu.

- Pieskarieties pie , lai filtrētu. Filtri tiek lietoti tikai pašreizējam attēlam un tad, kad šis attēls tiek koplietots. Oriģinālie nefiltrētie attēli tiek saglabāti.
- Pieskarieties pie  un tad uznirstošajā izvēlnē pieskarieties pie OK (Labi), lai pārvietotu attēlu uz otru pusi (*nav pieejams izmeklējumiem, kuriem beidzies derīguma termiņš*). Šī funkcija ir noderīga, ja sākot attēlu tveršanu, ir izvēlēta nepareizā puse.
- Pieskarieties pie , lai dzēstu attēlu, tad apstipriniet dzēšanu (*nav pieejams izmeklējumiem, kuriem beidzies derīguma termiņš*).



Pāriet uz sarakstu *Lietotnes funkciju izmantošana*

Izmeklējuma saglabāšana (Android)

Attiecas uz: mācību režīms

1. Pievienojiet informāciju par pacientu.
2. Pieskarieties pie **Save** (Saglabāt).



PIEZĪME. Lai saglabātu izmeklējumu, attēli nav nepieciešami. Papildinformāciju par pacientu var pievienot pirms vai pēc attēlu atlasīšanas.



PIEZĪME. Izmeklējumu var saglabāt tikai pēc nepieciešamās informācijas ievadīšanas.


The screenshot displays the 'Exam' screen in training mode. At the top, there is a navigation bar with a back arrow, the title 'Exam', and icons for sharing and deleting. Below this is a 'Patient information' section with fields for Exam date (January 13, 2021 1:51:32 AM EST), Patient name (Andy), Date of birth (Jan 1, 1961), MRN (1), and Hx (Hx1). The 'Right' view section shows two image thumbnails and three 'Add image' buttons. The 'Left' view section shows five 'Add image' buttons. At the bottom, there are 'CANCEL' and 'SAVE' buttons. A blue box highlights the 'SAVE' button. Below the buttons, a warning message reads: 'This mode is for training purposes only. No individually identifiable patient data or personal data should be entered.'

Pāriet uz sarakstu *Lietotnes funkciju izmantošana*

Saglabāta izmeklējuma atjaunināšana (Android)

Attiecas uz: mācību režīms

1. Ja vēlaties rediģēt izmeklējumu, pieskarieties nepieciešamajam izmeklējuma nosaukumam, lai atvērtu izmeklējumu.

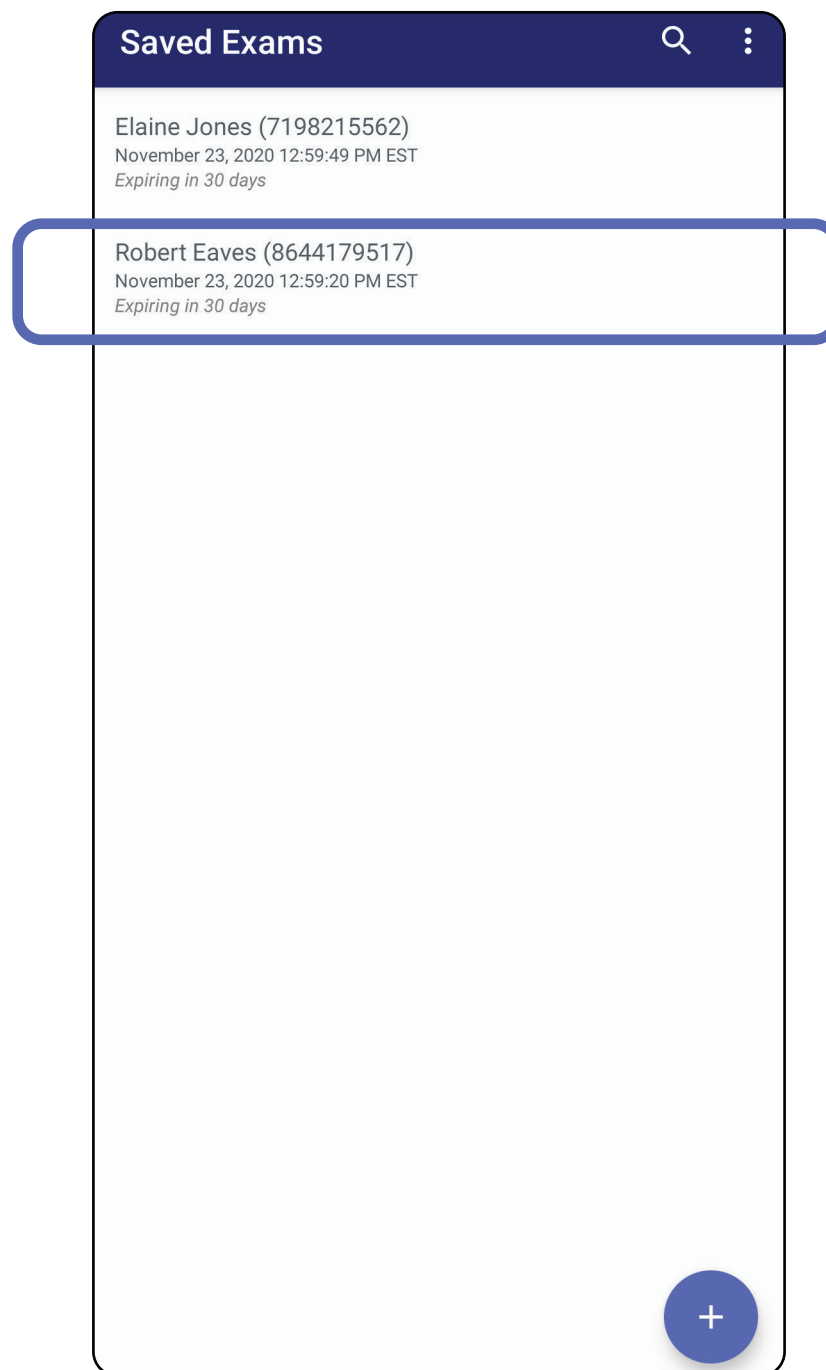



2. Izmeklējuma ekrānā pieskarieties laukam, ko vēlaties atjaunināt.

Pāriet uz sarakstu *Lietotnes funkciju izmantošana*

3. Ievadiet pacienta informāciju.
 - a. Izmantojiet uznirstošo tastatūru vai cipartastatūru, lai ievadītu pacienta vārdu vai MRN (medicīniskās dokumentācijas numuru).
 - b. Izmantojiet uznirstošo kalendāru, lai atlasītu dzimšanas datumu.



PIEZĪME. Kalendāra stils atšķiras atkarībā no Android versijas.

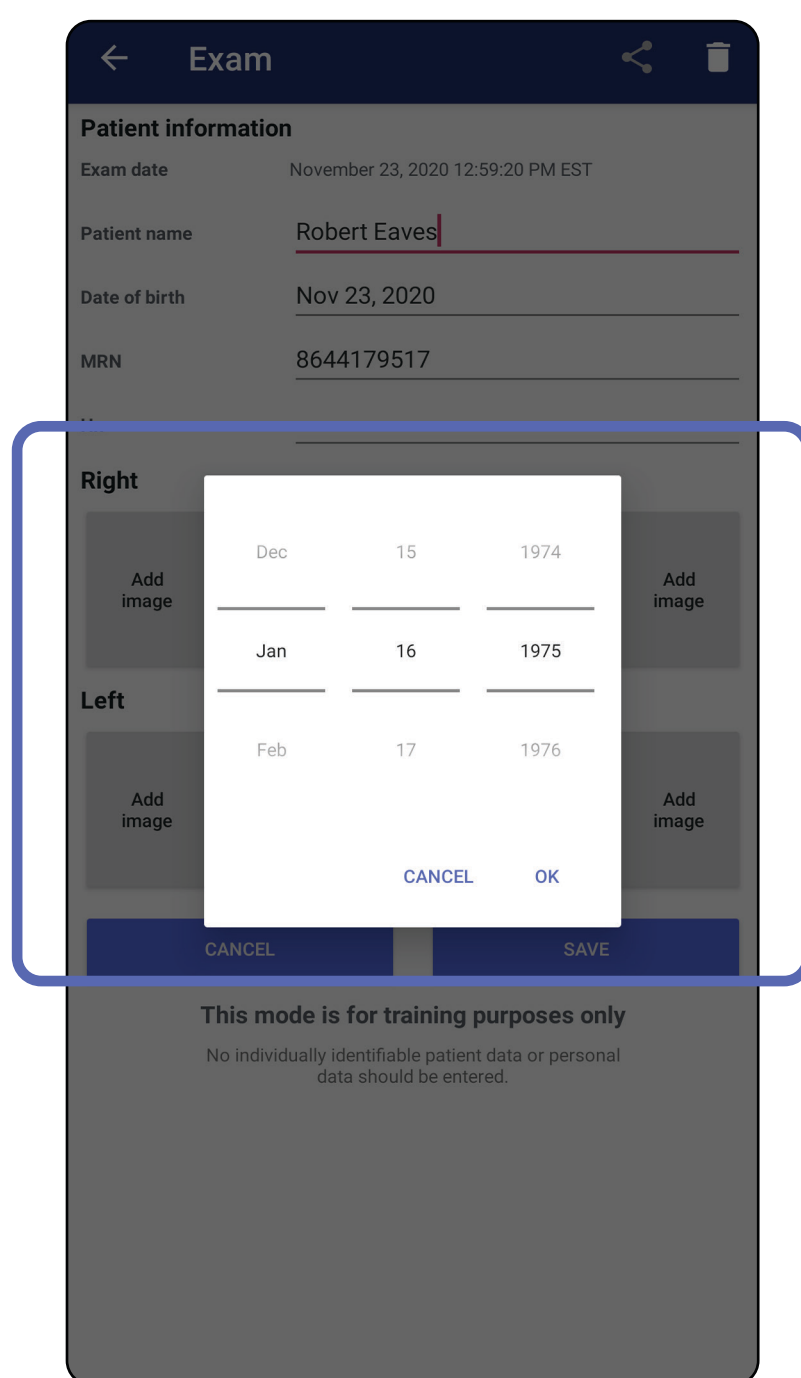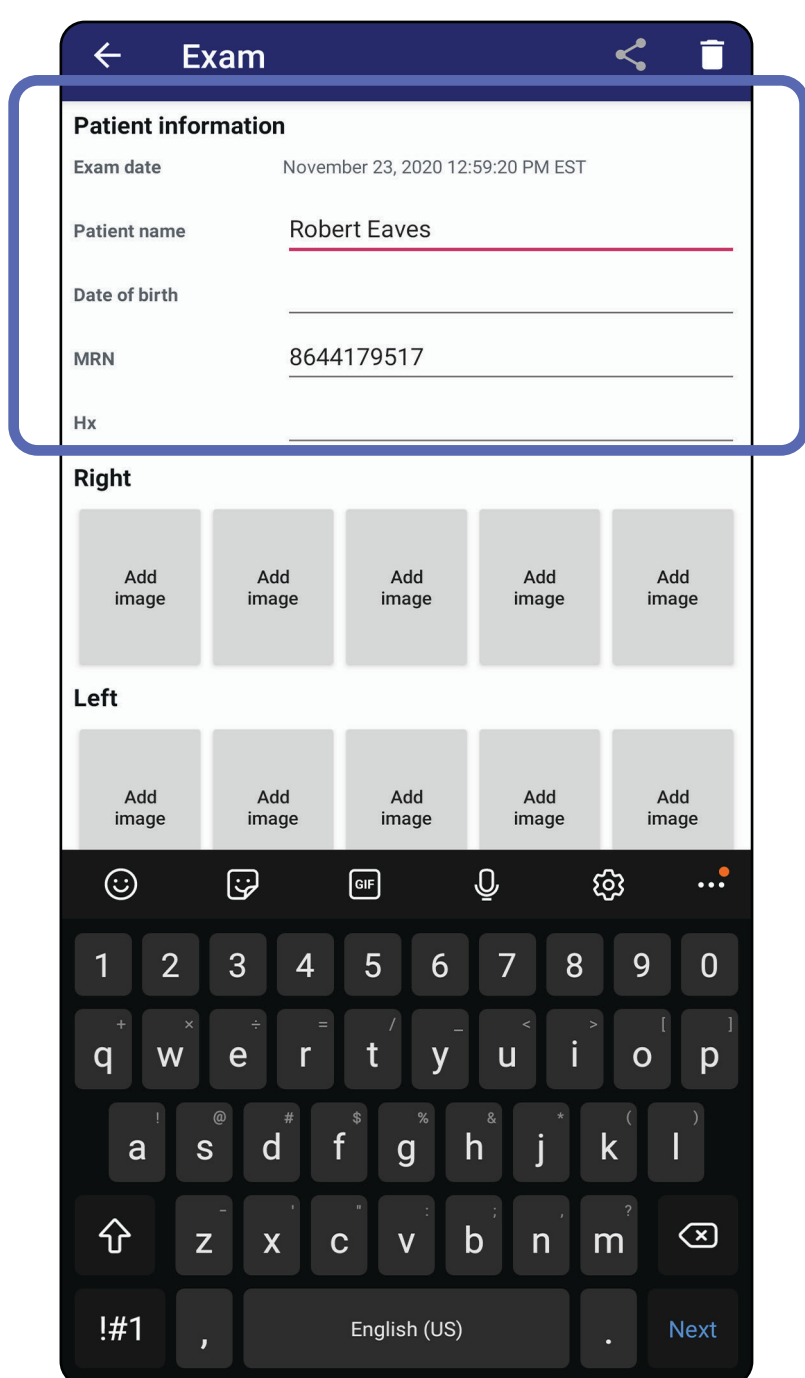

4. Pievienojiet vai noņemiet attēlus. Skatiet sadaļu [Attēlu tveršana \(Android\)](#) un sadaļu [Attēlu filtrēšana, pārvietošana un dzēšana \(Android\)](#).
5. Pieskarieties pie **Save** (Saglabāt).




PIEZĪME. Saglabāšana ir pieejama tikai tad, ja notiek izmaiņas un ir aizpildīta nepieciešamā pacienta informācija.

Pāriet uz sarakstu *Lietotnes funkciju izmantošana*


Izmeklējuma koplietošana (Android)

Attiecas uz: mācību režīms, klīniskais režīms

1. Izmeklējumu ekrānā pieskarieties pie .
2. Uznirstošajā izvēlnē atlasiet koplietošanas metodi.




PIEZĪME. Koplietošanas ikona ir pieejama tikai tad, ja izmeklējumā ir vismaz 1 attēls un nepieciešamā pacienta informācija.

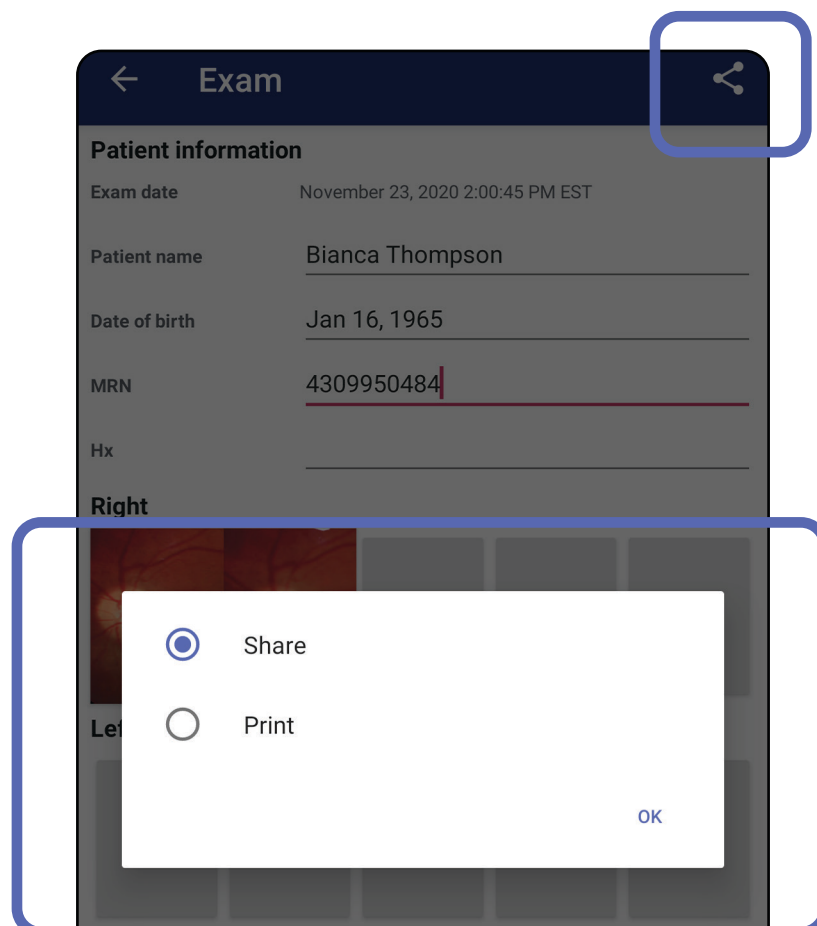

Pāriet uz sarakstu *Lietotnes funkciju izmantošana*

3. Lai koplietotu, sekojiet uzvednēm.

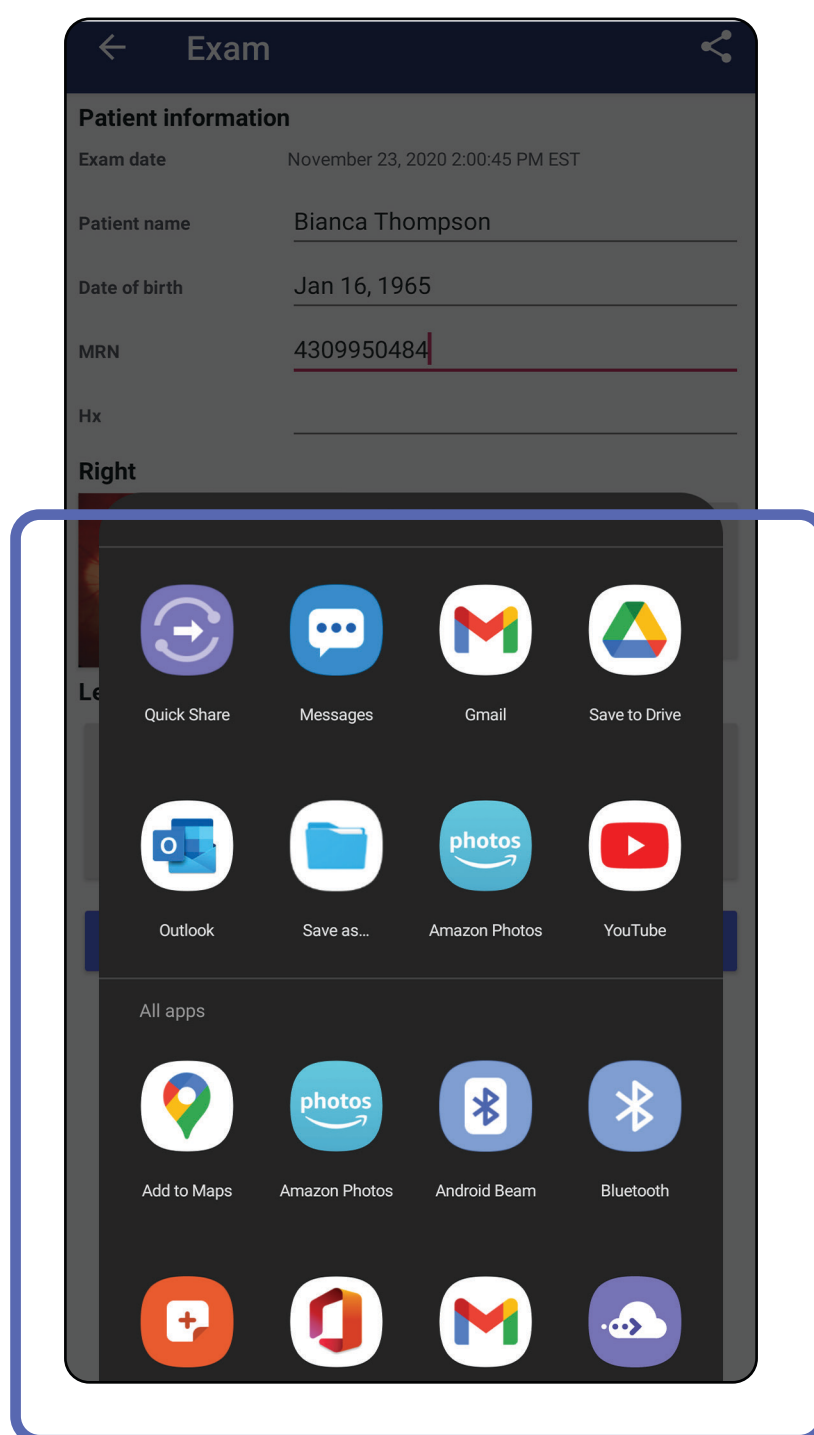

PIEZĪME. Skatiet sadaļu [Ierīces un pacienta dati un drošība](#).




PIEZĪME. Lietotnes iExaminer koplietotajos attēlos var būt iegulta informācija. Dažas fotoattēlu apskates programmas neatbalsta iegulto informāciju. Ja saņēmējs nevar apskatīt fotoattēlu, saņēmējam jāpārlicinās, vai fotoattēlu apskates programma atbalsta attēlu skatīšanu ar iegulto informāciju, vai arī jāizvēlas cita fotoattēlu apskates programma.

Pāriet uz sarakstu *Lietotnes funkciju izmantošana*


Attēla koplietošana (Android)

Attiecas uz: mācību režīms, klīniskais režīms

1. Izmeklējumu ekrānā pieskarieties nepieciešamajam attēlam.
2. Pieskarieties pie .




PIEZĪME. Koplietošana ir pieejama, ja izmeklējumā ir norādīta nepieciešamā pacienta informācija.

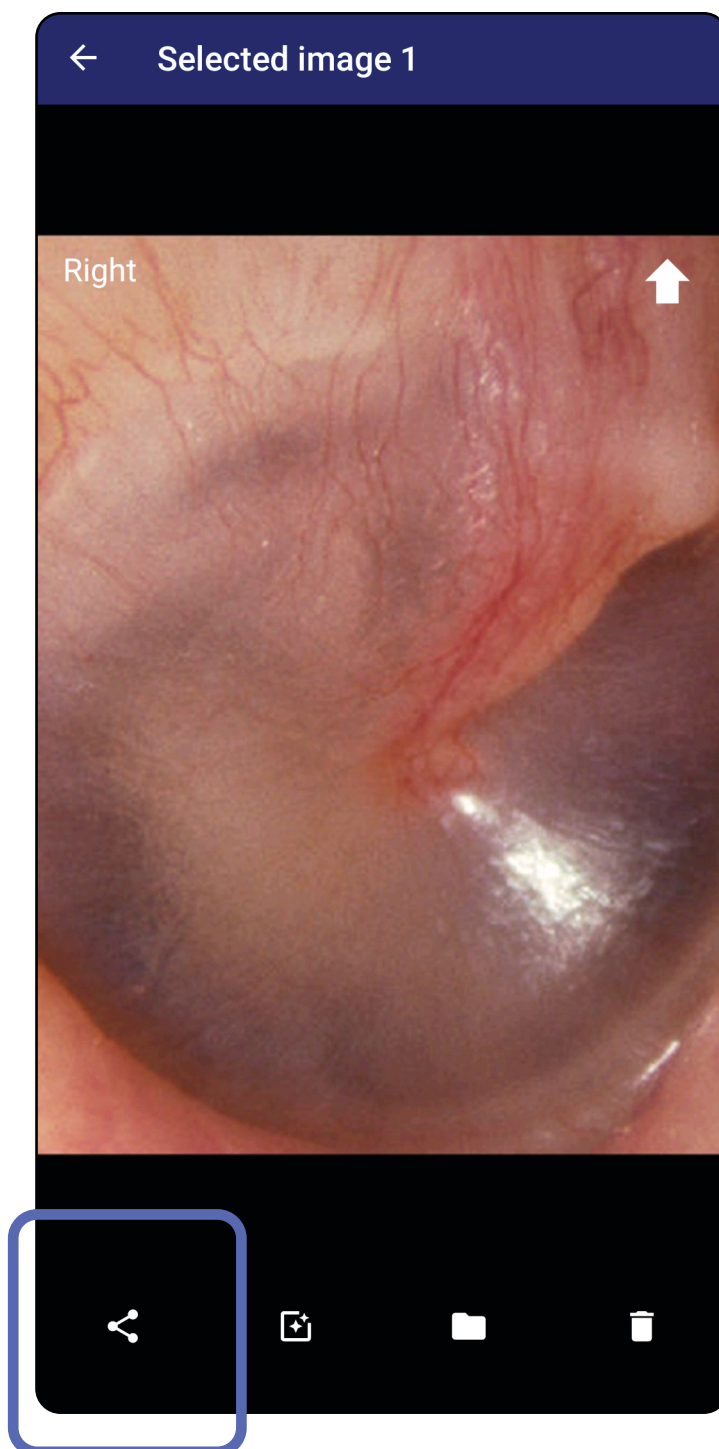

Pāriet uz sarakstu *Lietotnes funkciju izmantošana*

3. Uznirstošajā izvēlnē atlasiet koplietošanas metodi.

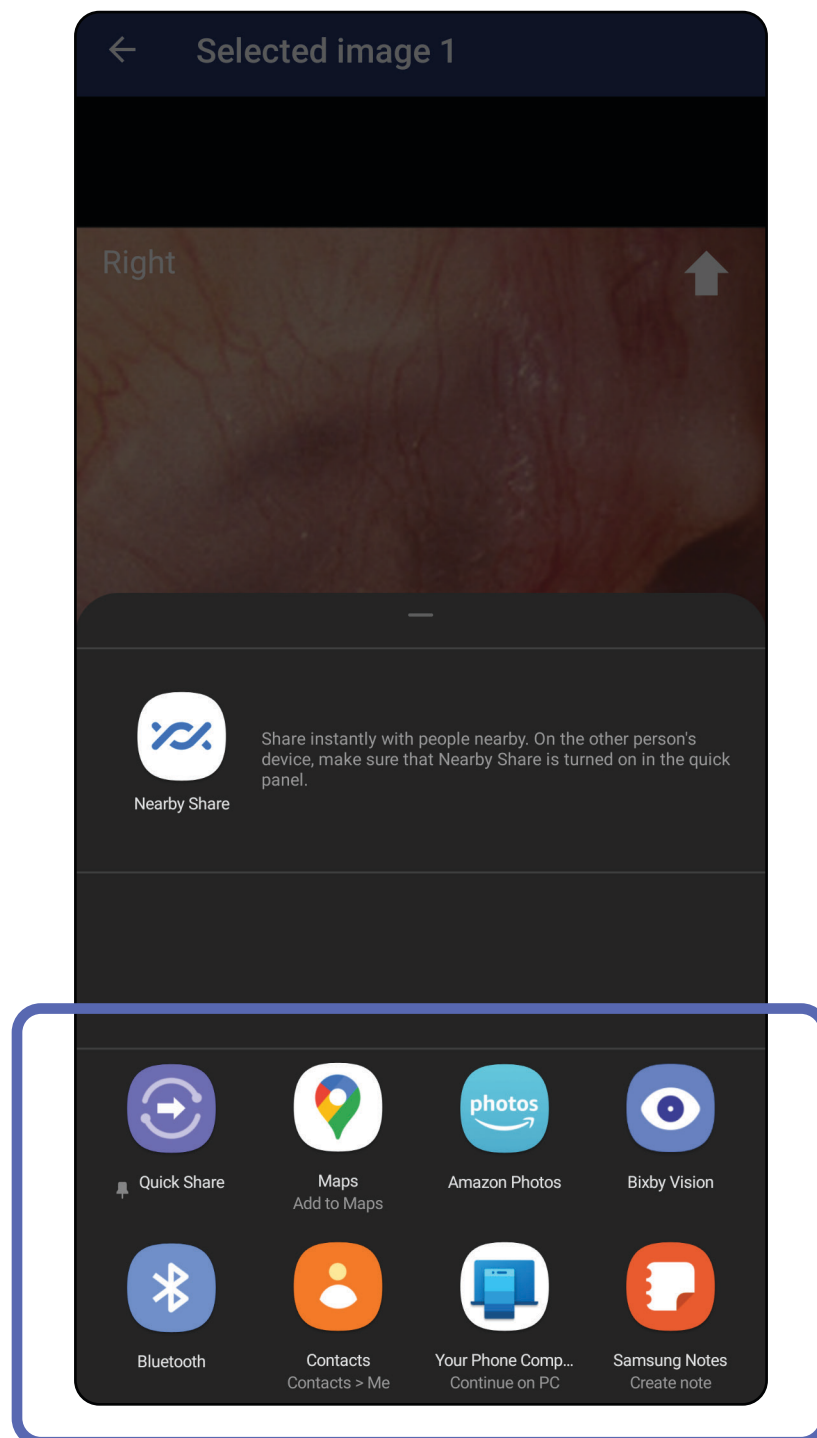

4. Lai koplietotu, sekojiet uzvednēm.



PIEZĪME. Skatiet sadaļu [Ierīces un pacienta dati un drošība](#).




PIEZĪME. Lietotnes iExaminer koplietotajos attēlos var būt iegulta informācija. Dažas fotoattēlu apskates programmas neatbalsta iegulto informāciju. Ja saņēmējs nevar apskatīt fotoattēlu, saņēmējam jāpārliedzinās, vai fotoattēlu apskates programma atbalsta attēlu skatīšanu ar iegulto informāciju, vai arī jāizvēlas cita fotoattēlu apskates programma.

Pāriet uz sarakstu *Lietotnes funkciju izmantošana*

Izmeklējuma dzēšana (Android)

Attiecas uz: mācību režīms

Pavilkot pa kreisi vai pa labi uz izmeklējuma nosaukuma, kuram ir beidzies derīguma termiņš.

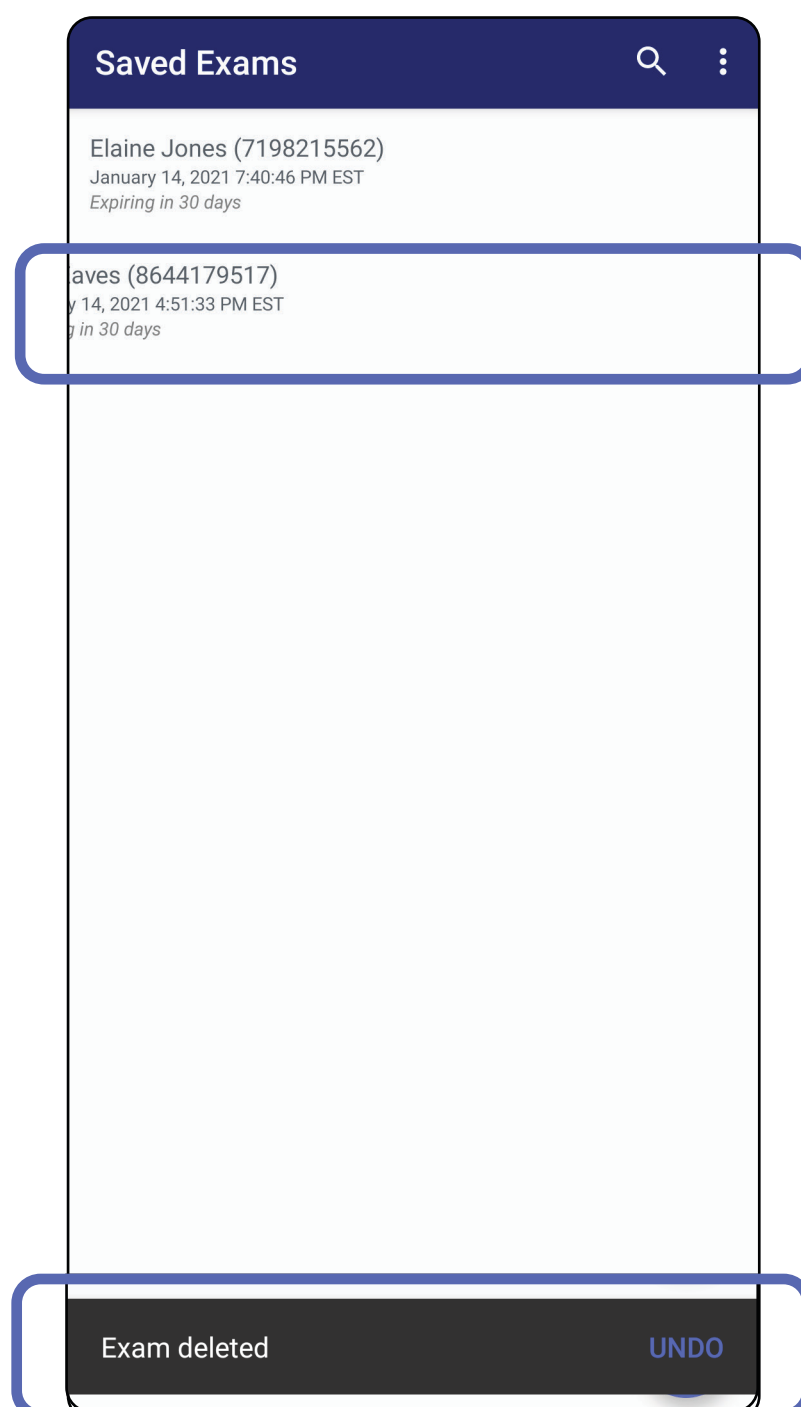


Uznirstošajā logā 15 sekunžu laikā pieskarieties pie **UNDO** (Atsaukt), lai atsauktu dzēšanu.

Izmeklējuma atmešana (Android)

Attiecas uz: klīniskais režīms

1. Lai atmestu izmeklējumu, pieskarieties pie **New** (Jauns).

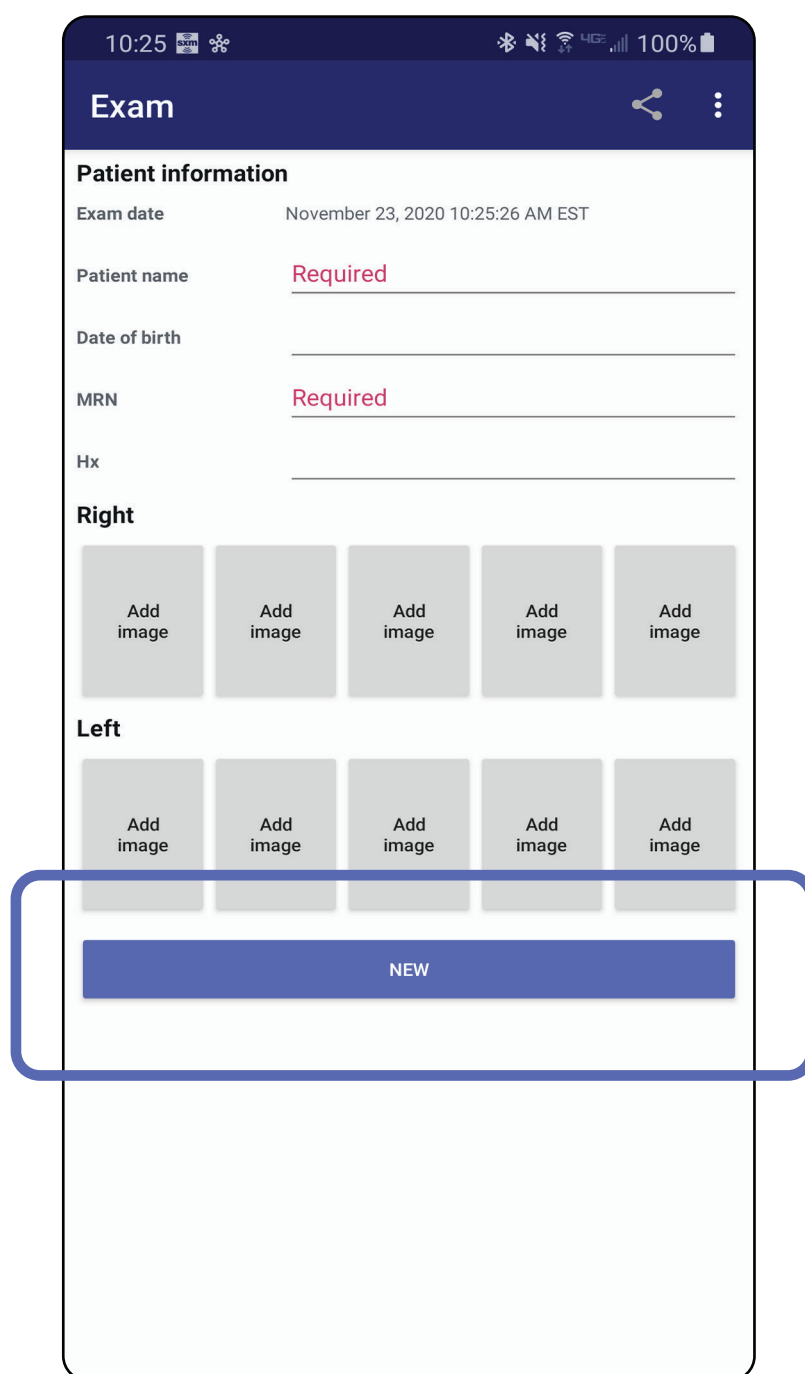

2. Pieskarieties pie **OK** (Labi), lai atmestu izmaiņas un sāktu jaunu izmeklējumu.

Tīrīšana

Šīs tīrīšanas instrukcijas ir paredzētas SmartBracket un SmartClip. Informāciju par Welch Allyn ierīču atkārtotu apstrādi skatiet atbilstīgajā lietošanas pamācībā.

 **UZMANĪBU!** Nesterilizējiet ierīces SmartBracket vai SmartClip vai neiemērciet to šķīdumos.

Šim izstrādājumam nav jāveic nekāda cita apkope, izņemot tīrīšanu.

Apstiprinātie tīrīšanas ķīmiskie līdzekļi.

- 70% izopropilspirts (piemēram, CiDehol® 70 spirta salvetes).
 - Metrex™ CaviWipes®
 - PDI Super-Sani-Cloth®
 - PDI-Sani-Cloth Plus®
1. Pirms tīrīšanas noņemiet SmartBracket no uzgaļa un SmartClip. Atstājiet SmartClip piestiprinātu pie korpusa.
 2. Lai atbrīvotos no redzamajiem un neredzamajiem netīrumiem, SmartBracket un SmartClip izmantojiet apstiprinātus tīrīšanas līdzekļus (skatiet iepriekš). Biežums — tīriet pēc nepieciešamības.
 3. Ļaujiet tīrīšanas šķīdumam nožūt.

Droša utilizācija

SmartBracket un SmartClip utilizācija jāveic saskaņā ar turpmāk minēto.

1. Izpildiet tīrīšanas instrukcijas atbilstoši norādēm, kas sniegtas šajā lietošanas pamācības sadaļā.
2. Sašķirojiet materiālus, lai sagatavotu tos pārstrādei.
 - Komponenti ir jāatvieno un jānodod pārstrādei atbilstīgi materiāla veidam.
 - o Plastmasa ir jāpārstrādā kā plastmasas atkritumi.
 - o Metāli ir jāpārstrādā kā metāli.
 - Ietver skrūves un stiprinājumus.

Norādījumus par utilizāciju skatiet atbilstīgo uzgaļu lietošanas pamācībās.

Izpildiet ražotāja norādījumus par viedtālruna un korpusa utilizāciju. Lai saglabātu konfidencialitāti, dzēsiet visus esošos datus, kas saistīti ar pacientiem/slimnīcu/klīniku/ārstu. Pirms dzēšanas var veikt datu dublēšanu.

Lietotājiem jāievēro visi valsts, reģiona un/vai vietējie likumi un noteikumi, kas attiecas uz drošu atbrīvošanos no medicīniskām ierīcēm un piederumiem. Šaubu gadījumā ierīces lietotājam vispirms ir jāsazinās ar uzņēmuma Hillrom tehniskā atbalsta dienestu, lai saņemtu norādījumus par drošu atbrīvošanos.

EMS atbilstība

Informāciju par elektromagnētisko saderību (EMS) skatiet Hillrom vietnē hillrom.com.

Glabāšana un transportēšana

Skatiet atbilstīgo Welch Allyn ierīces lietošanas pamācību.

Piederumi

Piederumus un lietotās daļas skatiet atbilstīgās Welch Allyn ierīces lietošanas pamācībā.

Saderīgās ierīces

Skatiet atbilstīgo Welch Allyn ierīces lietošanas pamācību.

Garantija

Welch Allyn, Inc. garantē, ka Welch Allyn iExaminer SmartBracket un SmartClip nav materiālu un ražošanas oriģinālo defektu un tie darbosies atbilstoši ražotāja specifikācijām vienu gadu pēc pirkuma datuma. Ja garantijas laikā šim instrumentam tiek konstatēts defekts vai neatbilstība ražotāja specifikācijām, Welch Allyn remontēs vai nomainīs instrumentu vai komponentu, nepiemērojot par to maksu pircējam. Šī garantija attiecas tikai uz Welch Allyn iExaminer SmartBracket un SmartClip, kas iegādāts jauns no Welch Allyn vai tā pilnvarotajiem izplatītājiem vai pārstāvjiem. Pircējam ir jānosūta SmartBracket un SmartClip tieši Welch Allyn vai pilnvarotam izplatītājam vai pārstāvim un jāsedz sūtījuma izmaksas.

Šī garantija neattiecas uz bojājumiem vai kļūmēm, kas saistīti ar iejaukšanos, nepareizu lietošanu, nolaidību, negadījumiem, pārveidošanu vai sūtīšanu. Šī garantija zaudē spēku, ja instruments netiek lietots saskaņā ar ražotāja ieteikumiem vai tiek remontēts.